GUÍA RÁPIDA


COMPASS GPS

AUDIOMETRÍA

Introducción

Esta guía rápida explica la sección AUDIOMETRÍA. Puede acceder a la herramienta Audiometría en INICIO DE SESIÓN y ADAPTACIÓN. Esta herramienta contiene la información sobre el audiograma, REUG y RECD. No puede medir un audiograma en esta ventana. Debe utilizar el módulo de audiograma conectado a su base de datos o la opción Introducir audiograma en la base de datos autónoma COMPASS GPS. COMPASS utilizará los datos de éste para calcular la adaptación del audífono.

Audiograma

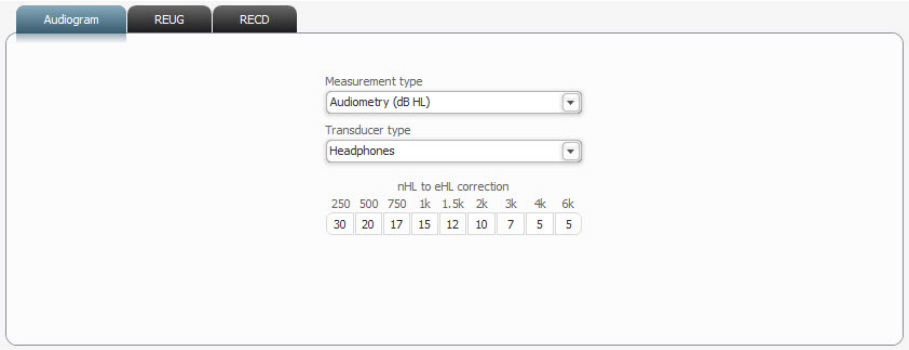

La ficha del audiograma está situada en la parte inferior del espacio de trabajo. Esta ficha le permite registrar las condiciones audiométricas utilizadas para la medición del audiograma. Se toman en cuenta las condiciones a la hora de interpretar los umbrales de audición utilizados para la adaptación.
En esta ficha tiene las siguientes opciones a su disposición:

- Seleccione un tipo de Medición de la lista. Puede elegir entre audiometría de comportamiento (Audiometría, dB HL), potenciales evocados del tronco cerebral establecida en un nivel de audición normalizado en dB (ABR, dB, nHL) y potenciales evocados del tronco cerebral o audiometría de estado estable establecida en niveles de audición calculados en dB (ABR/ASSR, dB eHL).


- Seleccione un Tipo de transductor en la lista. El tipo de transductores a su disposición depende del modo de medición seleccionado. Puede elegir entre Auricular de inserción y adaptador de goma espuma y

Auricular de inserción y molde. Sin embargo, si elige Audiometría (dB HL), tiene más opciones: Auriculares, Campo libre (0°), Campo libre (45°) y Campo libre (90°).

- Puede cambiar la corrección de nHL a eHL, pero solo si ha elegido la opción ABR (dB nHL) como tipo de medición.

REUG

La ficha REUG está al lado de la ficha Audiograma. Aquí puede introducir cualquier valor de REUG medido para el cliente. COMPASS utilizará estos datos de éste para corregir la adaptación del audífono.

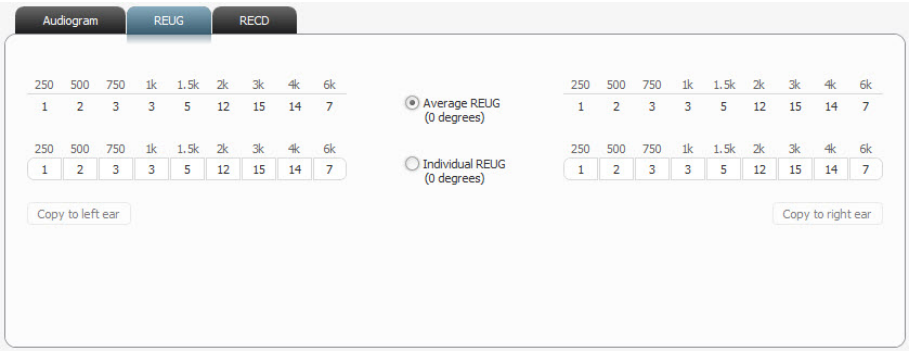


Empiece seleccionando si desea utilizar valores medios o individuales de REUG mediante os botones de radio. El ajuste predeterminado es Promedio.

Podrá cambiar los valores en intervalos de 1 dB. Si desea copiar los valores individuales de REUG al oído opuesto, utilice el botón Copiar a derecho/izquierdo.

RECD

La ficha RECD está al lado de la ficha REUG. Aquí puede introducir cualquier valor de RECD medido para el cliente. COMPASS utilizará estos datos de éste para corregir la adaptación del audífono.

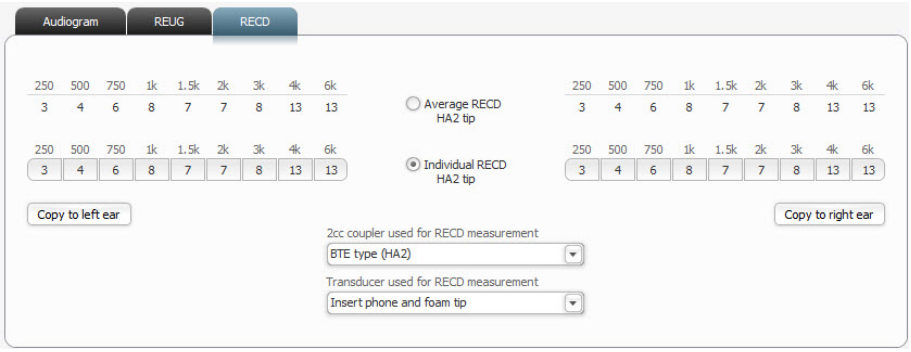

Empiece seleccionando si desea utilizar valores medios o individuales de RECD mediante los botones de radio. El ajuste predeterminado es Promedio.

Si selecciona los valores individuales de RECD, seleccione el acoplador 2cc y el tipo de transductor utilizados para la medición de RECD. Después introduzca los valores medidos en los campos correspondientes.

Podrá cambiar los valores en intervalos de 1 dB. Si desea copiar los valores individuales de RECD al oído opuesto, utilice el botón Copiar a derecho/izquierdo.

Para más información utilice el sistema de Ayuda situado en la barra de navegación superior o pulse la tecla F1 en el teclado.

GUÍA RÁPIDA

Este documento se suministra en versión electrónica. Puede solicitar una versión impresa sin costo adicional en http://widex.pro/gps-startup-guide. El plazo de entrega estimado es de 7 jornadas laborales. Este documento también está a su disposición en http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Reservados todos los derechos

Versión de documento: 2.0. Fecha de emisión: 2019-11