COMPASS GPS


AUDIOMETRIA

Aluksi

Tässä pikaoppaassa käsitellään COMPASSin Audiometria-työkalua. Audiometria löytyy sekä KÄYNNIN ALOITUS että SOVITUS-osioista. Audiometriassa on audiogrammi-, REUG- ja RECD-tiedot. Tätä kautta ei voi kuitenkaan tehdä varsinaista audiogrammi-mittausta. Sinun täytyy käyttää tietokantaasi yhdistettyä audiogrammi-moduulia tai COMPASS GPS:n erillisen tietokannan *Lisää audiogrammi* -valintaa. COMPASS käyttää audiogrammi-tietoja laskelmissaan kuulokojesovitusta varten.

Audiogrammi

Audiogrammi-välilehti on ikkunan alaosassa. Välilehdelle rekisteröidään asiakkaan audiogrammin mittaamisessa käytetyt audiometriset valinnat. Nämä tiedot otetaan huomioon, kun COMPASS tulkitsee kuulokojesovituksessa käytettäviä kuulokynnyksiä. Tällä välilehdellä on seuraavat valinnat:

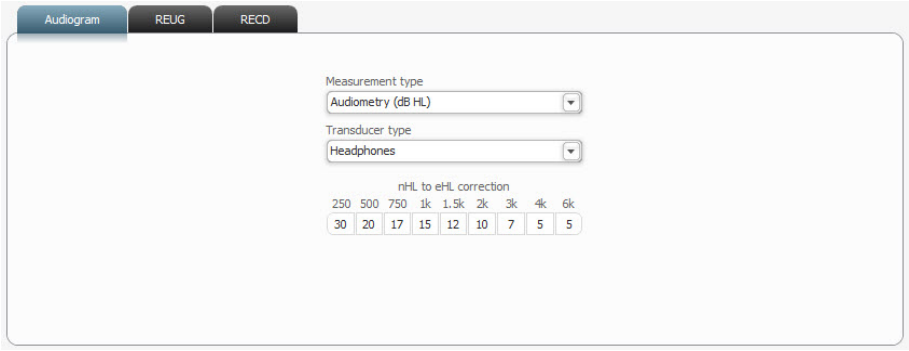


- *Mittaustapa* pudotusvalikosta. Valittavissa on tavallinen audiometria (Audiometria, dB HL), aivorunkoherätemittaus (ABR, dB nHL) tai aivorunkoherätemittaus tai aivokuoren kuulovasteiden mittaus arvioidulla kuulotasolla (ABR/ASSR dB eHL).

- *Kuuloketyyppi* pudotusvalikosta. Valittavissa olevat kuulokkeet riippuvat valitusta mittaustavasta. On aina mahdollista valita joko *Inserttikuuloke ja vaahtomuovitippi* tai *Inserttikuuloke ja korvakappale*. Mutta jos mittaustavaksi on valittu Audiometria (dB HL), valintamahdollisuuksia on useampia. Nämä ovat *Kuulokkeet, Vapaakenttä (0°), Vapaakenttä (45°)* ja *Vapaakenttä (90°)*.

- Jos olet valinnut mittaustavaksi ABR (dB nHL), voit muuttaa *nHL*-arvot *eHL korjausarvoiksi* sovituksessa käytettäviksi.

REUG

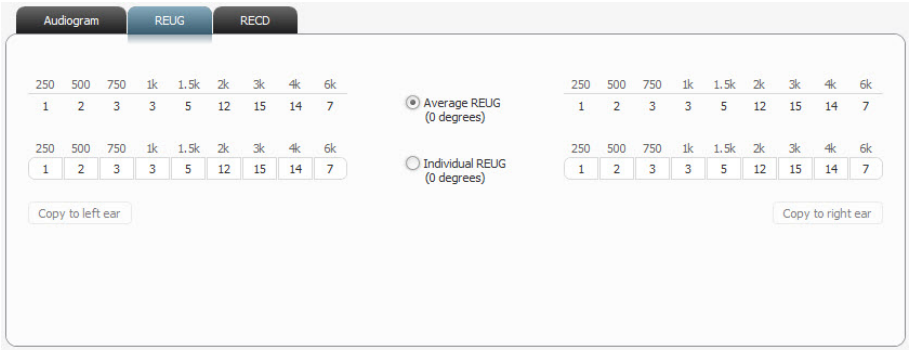


REUG-välilehti on Audiogrammi-välilehden vieressä. REUG-välilehdelle voidaan tallentaa asiakkaalta mitatut yksilölliset REUG-arvot. COMPASS käyttää yksilöllisiä REUG-arvoja korjatakseen kuulokojesovitusta.

Aloita valitsemalla haluatko käyttää keskimääräisiä vai yksilöllisiä REUG-arvoja valintanäppäimillä ruudun keskellä. Oletuksena on aina keskimääräinen.

REUG-arvoja voi muuttaa 1 dB:n välein. Jos haluat kopioida yksilölliset REUG-arvot toiseen korvaan, käytä näppäintä *Kopioi oikealle/vasemmalle*.

RECD

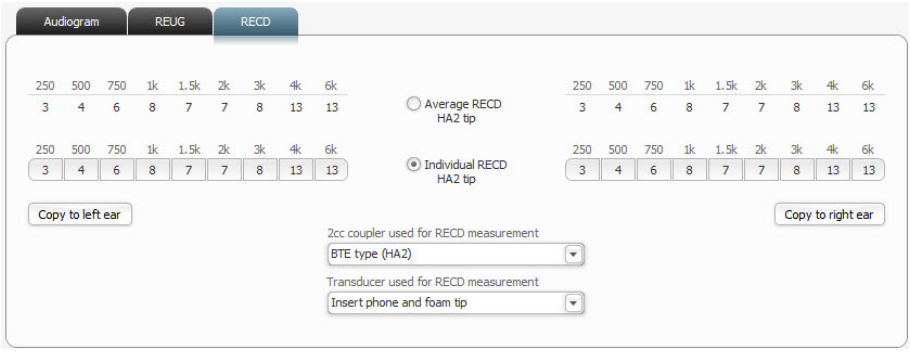

RECD-välilehti on REUG-välilehden vieressä. RECD-välilehdelle voidaan tallentaa asiakkaalta mitatut yksilölliset RECD-arvot. COMPASS käyttää yksilöllisiä RECD-arvoja korjatakseen kuulokojesovitusta.

Aloita valitsemalla haluatko käyttää keskimääräisiä vai yksilöllisiä RECD-arvoja valintanäppäimillä ruudun keskellä. Oletuksena on aina keskimääräinen.

Jos käytät yksilöllisiä RECD-arvoja, valitse RECD-mittauksessa käytetty 2cc-liitin ja kuuloketyyppi. Lisää sitten mitatut arvot kenttiin.

Arvoja voi muuttaa 1 dB:n välein. Jos haluat kopioida yksilölliset RECD-arvot toiseen korvaan, käytä näppäintä *Kopioi oikealle/vasemmalle*.

Lisätietoja ja ohjeita saadaksesi avaa Ohje-tiedosto (HELP) COMPASS-sovitusohjelman ylimmästä navigointipalkista tai painamalla näppäimistön F1-näppäintä.

Tämä dokumentti on elektronisessa muodossa. Paperiversio oppaasta on saatavilla ilmaiseksi osoitteesta http://widex.pro/gps-startup-guide, toimitusaika on n. 7 viikonpäivää. Dokumentin voi myös saada osoitteesta http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Kaikki oikeudet pidätetään

Dokumenttiversio: 2.0. Julkaistu: 2019-11