GUIA DE CONSULTA RÁPIDA


COMPASS GPS

AUDIOMETRIA

Introdução

Este guia rápido explica como usar a ferramenta Audiometria no COMPASS GPS. Vai encontrar a ferramenta Audiometria em INICIAR SESSÃO e nos temas ADAPTAÇÃO. A ferramenta Audiometria contem informação sobre o audiograma, REUG e RECD. Não pode, contudo, fazer a medição real do audiograma nesta janela. Tem de utilizar o módulo audiograma ligado à sua base de dados, ou a opção *Entrar no Audiograma* na base de dados autónoma do COMPASS GPS. O COMPASS depois utiliza os dados do audiograma para fazer cálculos para a adaptação do aparelho auditivo.

Audiograma

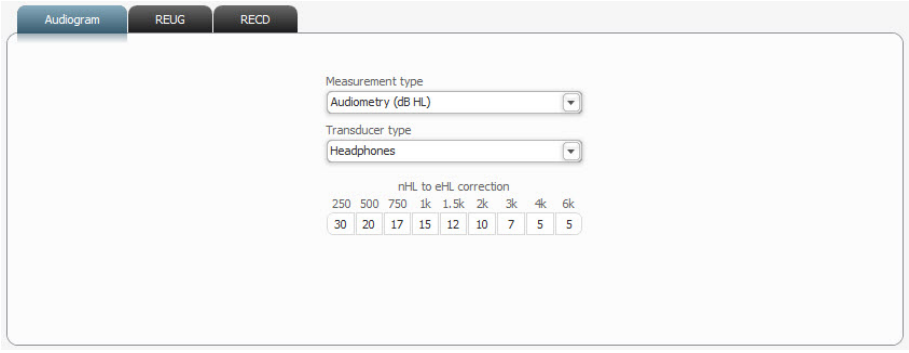

O separador audiograma está localizado na metade inferior da área de trabalho principal. Este separador permite-lhe registar as condições audiométricas utilizadas ao estabelecer o audiograma do cliente. As condições são tidas em consideração quando o COMPASS interpreta os limiares de audição utilizados na adaptação do aparelho auditivo. Tem as seguintes opções neste separador:


- Seleccione um *Tipo de medição* da lista suspensa. Pode escolher entre audiometria comportamental (Audiometria, dB HL), audiometria de tronco encefálico estabelecida no nível auditivo com dB normalizado (ABR, dB nHL), e audiometria de tronco encefálico ou resposta auditiva em estado estável estabelecidos no nível auditivo com dB estimado (ABR/ASSR, dB eHL).

- Seleccione um *Tipo de transdutor* da lista suspensa. A lista de transdutores disponíveis depende do tipo de medição selecionado. Pode sempre escolher entre *Inserir telefone e ponta de esponja* e *Inserir telefone e molde.* Mas se escolher Audiometria (dB HL) em Tipo de medição, terá mais escolhas. Estas são *Auscultadores, Campo livre (0º), Campo livre (45º9 E Campo livre (90º)*

- Pode alterar os valores de correção utilizados na adaptação, mas só se tiver escolhido a opção ABR (dB nHL) na caixa suspensa de Tipo de medida.

REUG

O separador REUG encontra-se ao lado do separador Audiograma. No separador REUG você pode introduzir quaisquer valores individuais de REUG que tenha medido para o seu cliente. O COMPASS depois utiliza os valores individuais de REUG para corrigir a adaptação do aparelho auditivo.

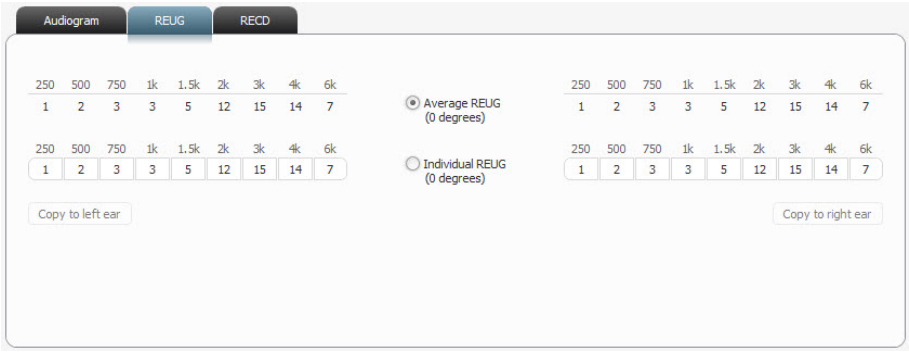


Comece por selecionar se quer utilizar os valores médios ou individuais de REUG através de botões de rádio no meio do separador. De fábrica são considerados os valores médios.

Pode alterar os valores de REUG em passos de 1 dB. Se quer copiar valores individuais de REUG para o ouvido oposto, utilize o botão *Copiar para o ouvido direito/esquerdo.*

RECD

O separador RECD encontra-se ao lado do separador REUG. No separador RECD você pode introduzir quaisquer valores individuais de RECD que tenha medido para o seu cliente. O COMPASS depois utiliza os valores individuais de RECD para corrigir a adaptação do aparelho auditivo.

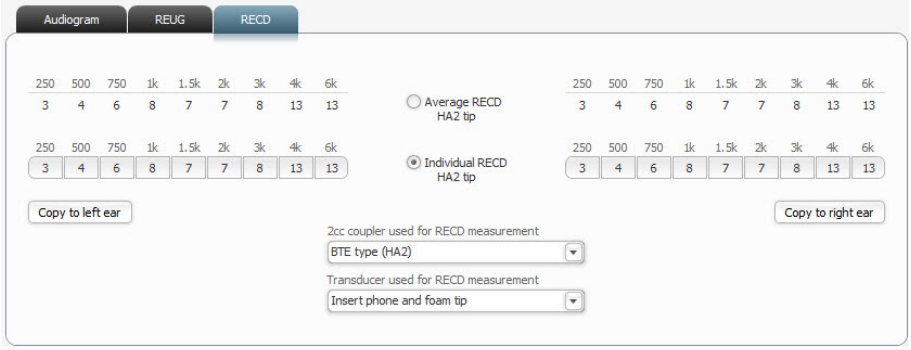

Comece por selecionar se quer utilizar os valores médios ou individuais de RECD através de botões de rádio no meio do separador. De fábrica são considerados os valores médios.

Se estiver a trabalhar com valores individuais de RECD, escolha o acoplador 2cc e o tipo de transdutor utilizado na medida RECD das listas suspensas. De seguida introduza os valores medidos nos campos.

Pode alterar os valores em passos de 1 dB. Se quer copiar valores individuais de RECD para o ouvido oposto, utilize o botão *Copiar para o ouvido direito/esquerdo.*

Para mais informação e orientação, abra o sistema de Ajuda na barra de navegação superior do programa COMPASS, ou prima o botão F1 no seu teclado.

Este documento é fornecido em formato eletrónico. Uma versão em papel destas instruções pode ser solicitada sem custo adicional em http://widex.pro/gps-startup-guide, com tempo previsto de entrega de 7 dias. Este documento também está disponível em http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Todos os direitos reservados

Versão do documento: 2.0. Emitida: 2019-11