
COMPASS GPS

АУДИОМЕТРИЯ

Введение

В данном руководстве содержится информация об инструменте Аудиометрия COMPASS GPS. Инструмент Аудиометрия находится в разделах НАЧАТЬ СЕАНС и НАСТРОЙКА. Инструмент Аудиометрия содержит аудиограмму и данные REUG и RECD. Однако вы не можете выполнить настоящее измерение аудиограммы в этом окне. Вам следует использовать модуль аудиограммы, подсоединенный к вашей базе данных, или опцию *Вести аудиограмму* в независимой базе данных COMPASS GPS. Затем COMPASS будет использовать данные аудиограммы для рассчета при настройке.

Аудиограмма

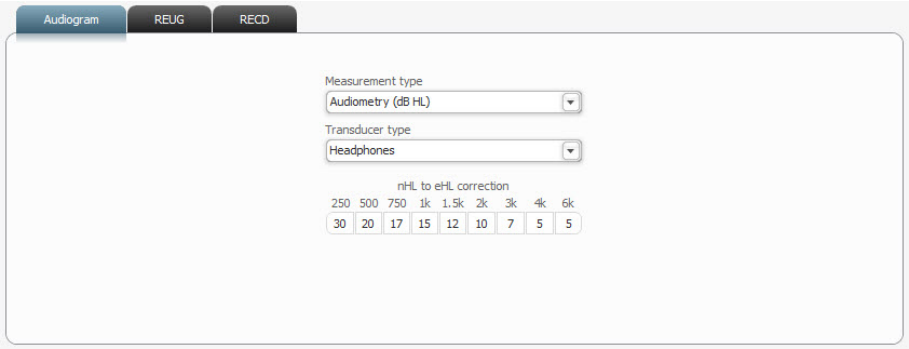

Вкладка Аудиограмма расположена в нижней части главной рабочей области. В этой вкладке регистрируются аудиометрические условия, используемые для измерения аудиограммы пациента. Условия принимаются в учет, когда COMPASS анализирует слуховые пороги, используемые для настройки слухового аппарата. В данной вкладке есть несколько возможностей выбора:

- Выбрать *Тип измерения* из выпадающего списка. Вы можете выбрать между поведенческой аудиометрией (Аудиометрия, дБ HL), слуховым ответом ствола мозга, зафиксированным на нормальном слуховом уровне в дБ (ABR, дБ nHL), и слуховым ответом ствола мозга или слуховым установившимся откликом, зафиксированным на оценочном слуховом уровне в дБ (ABR/ASSR, дБ eHL).


- Выбрать *Тип преобразователя* из выпадающего списка. Список доступных преобразователей зависит от выбранного типа измерения. Вы всегда можете выбрать между *поролоновым*

внутриушным телефоном и внутриушным телефоном с ушным вкладышем. Если вы выбираете Аудиометрия (дБ HL) в разделе Тип измерения, у вас будет большей опций. Это Наушники, Свободное поле (0°), Свободное поле (45°) и Свободное поле (90°).

- Вы можете изменить nHL на eHL, но только в том случае, если Вы выбрали ABR (дБ nHL) в разделе Тип измерения.

REUG

Вкладка REUG расположена рядом с вкладкой Аудиограмма. В этой вкладке вы можете внести индивидуальные значения REUG, измеренные для клиента. Затем COMPASS использует эти значения, чтобы скорректировать настройку.

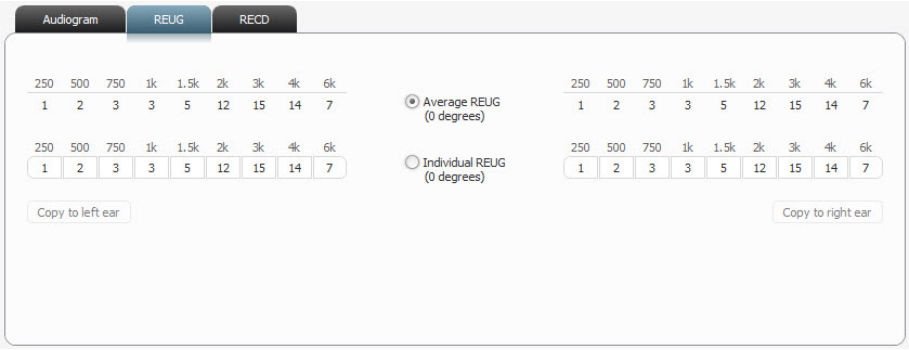


Начните стого, чтобы выбрать, хотите ли вы использовать средние или индивидуальные значения REUG с помощью кнопок-переключателей в центре вкладки. По умолчанию выбраны средние значения.

Вы можете изменять значения REUG шагами в 1 дБ. Если вы хотите скопировать индивидуальные значения REUG на другое ухо, используйте клавишу *Копировать на правое/левое ухо.*

RECD

Вкладка RECD расположена рядом с вкладкой Аудиограмма. В разделе RECD Вы можете внести значения RECD, измеренные для пациента. Затем COMPASS использует эти значения, чтобы скорректировать настройку.

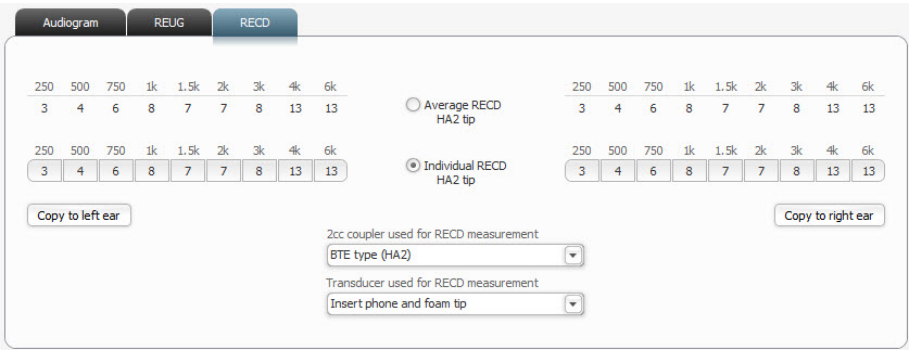

Начните с того, чтобы решить, хотите ли вы использовать средние или индивидуальные значения RECD. Сделать это вы можете с помощью кнопок-переключателей, расположенных в центре вкладки. По умолчанию выбраны средние значения.

Если вы работаете с индивидуальными значениями RECD, выберите камеру 2cc, используемую для измерения RECD, и выберите преобразователь, используемый для измерения RECD, из раскрывающегося списка. Затем введите измеренные значения в поля.

Шаг изменения значения равен 1 дБ. Если вы хотите скопировать индивидуальные значения RECD на другое ухо, используйте клавишу *Копировать на правое/левое ухо*.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Для получения более подробной информации откройте Справку на верхней навигационной панели программы COMPASS или нажмите клавишу F1 на Вашем экране.

Этот документ представлен электронном формате. Бумажную копию можно бесплатно запросить через сайт http://widex.pro/gps-startup-guide, она будет доставлена примерно через 7 календарных дней. Этот документ также доступен на http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Все права защищены

Версия документа: 2.0. Выход: 2019.11