
SNABBGUIDE

COMPASS GPS

CROS/BICROS

Inledning

I den här snabbguiden får du information om CROS/BiCROS-funktionen. Välj CROS/BiCROS i navigeringskolumnen till vänster i fönstret HANTERING.

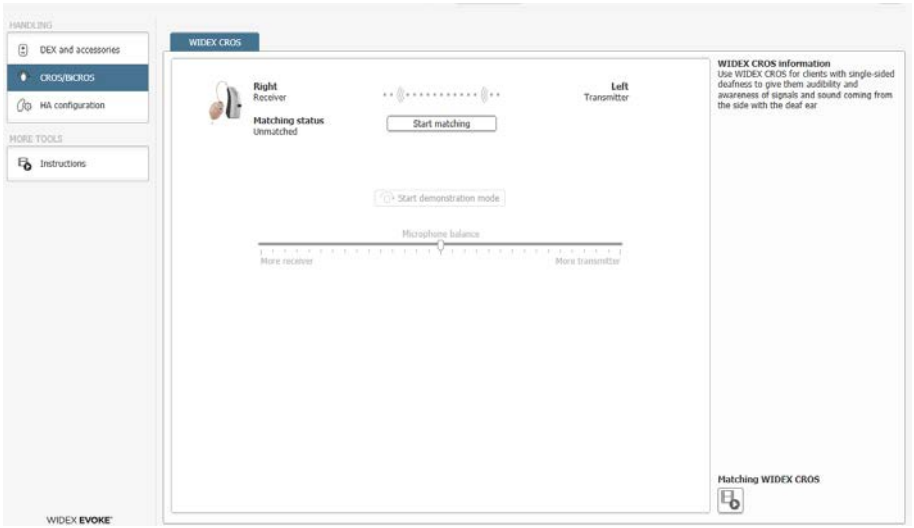

I en CROS-konfiguration genererar COMPASS automatiskt en anpassning i hörapparaten utifrån audiogrammet.

I en BiCROS-konfiguration ska du göra en monaural anpassning av den mottagande hörapparaten. Utför in situ-mätningar, Sensogram- och återkopplingstest och gör de eventuella finjusteringar som krävs för hörapparaten.

CROS/BICROS-fönstret

I det här fönstret kan du se CROS- eller BiCROS-matchningar och du kan starta en ny matchning. Under matchningen kan du välja inställningar i CROS- eller BiCROS-konfigurationen.

Matchningsprocessen

Matchningsprocessen påminner om DEX-matchningen. Observera att du inte kan göra en CROS- eller BiCROS-matchning i en binaural anpassning. Gör så här för att matcha en hörapparat och en WIDEX CROS i en CROS- eller BiCROS-konfiguration:

1. Välj knappen *Starta matchning*. Bredvid denna knapp ser du matchningsstatus och annan relevant information.

2. Välj antingen *CROS eller BiCROS* under *Välj typ* i dialogrutan som visas. Du kan se information om de olika typerna på skärmen.

3. Välj mikrofonläge till höger. Du kan välja mellan **Locator** och *Locator Omni*. Du kan se information om alternativen på skärmen.

4. Välj om Aktivera streaming automatiskt ska vara *På* eller *Av*. Om *Aktivera streaming automatiskt* är *På* startar streamingen automatiskt när sändardelen aktiveras genom att batteriluckan stängs.

5. Välj *Nästa* för att starta matchningen. Se till att hörapparaten och sändaren är inom funktionsområdet för programmeringsgränssnittet. Matchningen pågår nu.

6. Välj *OK* när dialogrutan Matchning slutförd visas.


Ljuddemonstration med CROS/BiCROS

Vi rekommenderar att du utför en ljuddemonstration av CROS/BiCROS-konfigurationen när du har matchat den mottagande hörapparaten med sändaren. På så sätt kan du se till att konfigurationen fungerar korrekt och att din klient har optimalt ljud.

1. Se till att den mottagande hörapparaten och sändaren sitter rätt i klientens öron.

2. Välj knappen *Starta demonstrationsläge* i mitten av CROS/BiCROS-fönstret så visas en dialogruta. I dialogrutan får du tips på hur du kan utvärdera ljudet. Se bilden till höger.

3. Aktivera sändaren/CROS-delen genom att trycka på programknappen. Klienten hör ett ljud när sändningen är aktiverad.

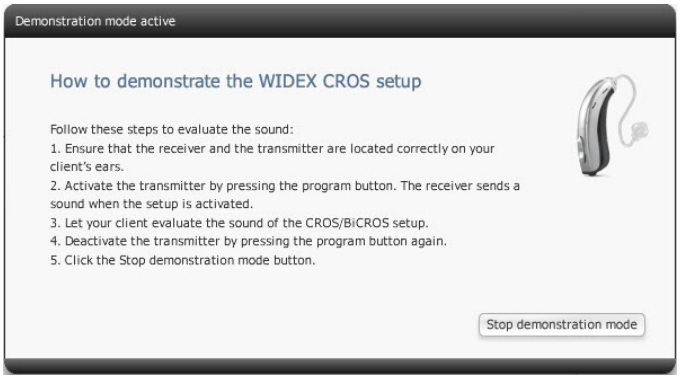

4. Låt klienten utvärdera ljudet. Justera vid behov *utsänt ljud* (i en CROS-konfiguration) eller *mikrofonbalans* (i en BiCROS-konfiguration). Du kan endast justera det ljud som har med CROS- eller BiCROS-konfigurationen att göra. Gå till Finjustering om du vill göra mer allmänna justeringar av ljudet.

5. Inaktivera sändaren/CROS-delen genom att trycka på programknappen igen.

6. Välj knappen *Avsluta demonstrationsläge* för att återgå till CROS/BICROS-fönstret. Sändaren/CROS-delen är endast aktiv i demonstrationsläget.

SNABBGUIDE

Detta dokument tillhandahålls i elektronisk form. Du kan begära en pappersversion av instruktionerna utan extra kostnad på http://widex.pro/gps-start-guide – förväntad leveranstid är sju kalenderdagar. Dokumentet är även tillgängligt på http://widex.pro/gps-start-guide.

För ytterligare information och hjälp, öppna Hjälpsystemet från det övre navigeringsfältet i COMPASS-programmet, eller genom att välja F1-knappen på ditt tangentbord.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversion: 2.0. Utfärdat: 2019-11