
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

COMPASS GPS

CROS/BICROS

Введение

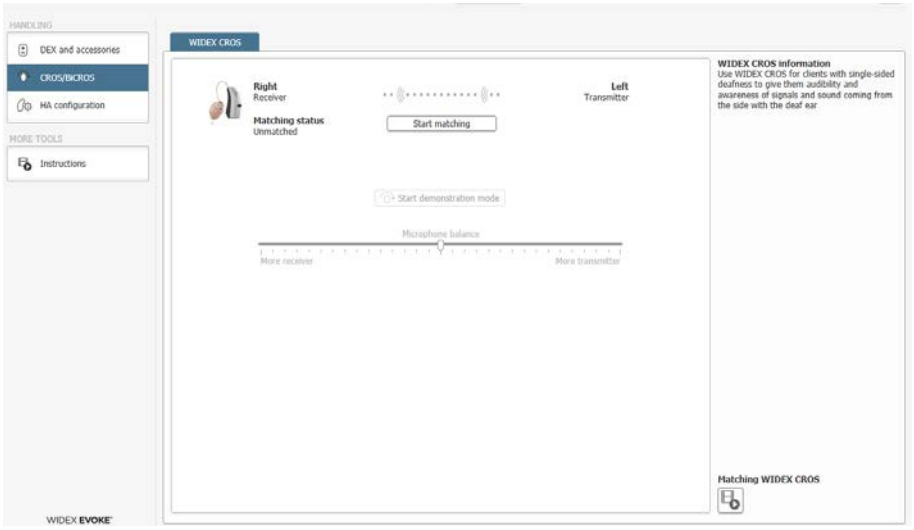

В этом руководстве представлена информация о функции CROS/BiCROS. Выберите CROS/BiCROS на навигационной панели слева в окне УПРАВЛЕНИ.

При выборе CROS, COMPASS автоматически производит настройку слухового аппарата на основе аудиограммы.

Выбирая BiCROS, вы должны вручную настроить принимающий слуховой аппарат. Проведите измерения in-situ, сделайте Сенсограмму и выполните тест обратной связи. Выполните точную настройку аппарата, если необходимо.

Окно CROS/BiCROS

В этом окне показано соответствие CROS или BiCROS, и вы можете провести новое соответствие. Во время сопряжения вы можете изменить настройки CROS или BiCROS.

Процедура сопряжения

Процедура соответствия похожа на сопряжение с DEX. Обратите внимание, что вы не можете проводить соответствие CROS или BiCROS при бинауральной настройке. Выполните следующее, чтобы провести сопряжение слухового аппарата и WIDEX CROS в установке CROS или BiCROS:

1. Выберите клавишу Провести соответствие.Рядом с этой клавишей Вы видите статус соответствия и другую информацию.

2. Выберите CROS или BiCROS в разделе Выбрать тип в диалоговом окне. Вы увидите информацию о выбранном типе на экране.

3. Справа выберите режим микрофона: Локатор или Локатор всенапр. На экране вы увидите информацию о выбранном типе.

4. Выберите, *Вкл.* или *Выкл.* для *Автозапуска передачи*. Если *Автозапуск передачи* включен, то передача начнется автоматически, когда передающий слуховой аппарат включится после закрытия батарейного отсека.

5. Нажмите клавишу Далее, чтобы начать процедуру соответствия. Убедитесь, что слуховой аппарат и передатчик находятся в радиусе действия программирующего интерфейса. Идет процедура установки соответствия.

6. Выберите OK, когда появится диалоговое окно Соответствие завершено.

Звуковая демонстрация CROS/BiCROS

Мы рекомендуем провести звуковую демонстрацию установки CROS/BiCROS после того, как вы провели соответствие между принимающим аппаратом и передатчиком. Таким образом Вы сможете быть уверенным, что настройки работают правильно и ваш пациент получает оптимальное звучание.

1. Убедитесь, что принимающий слуховой аппарат и передатчик правильно расположены на ушах пациента.

2. Выберите клавишу Начать демонстрацию в центре окна CROS/BiCROS, появится диалоговое окно. В этом окне содержатся советы, как правильно оценить звучание. См. рисунок справа.



3. Активируйте передатчик, нажав на программную кнопку. Принимающий аппарат посылает сигнал, когда передача активирована.

4. Позвольте своему пациенту самому оценить звучание. Если необходимо, дополнительно отрегулируйте Смещение усиления передаваемого звука (в установке CROS) или Баланс микрофонов (в установке BiCROS). Вы можете регулировать только звук, который относится к

установке CROS или BiCROS. Перейдите в раздел Точная настройка, если вы хотите провести более общие регулировки звука.

5. Деактивируйте передатчик, нажав на программную кнопку.

6. Выберите клавишу Остановить демонстрацию, чтобы вернуться в окно CROS/BiCROS. Передатчик активен только в демонстрационном режиме.

Для получения более подробной информации откройте Справку на верхней навигационной панели программы COMPASS или нажмите клавишу F1 на Вашем экране.

Этот документ представлен электронном формате. Бумажную копию можно бесплатно запросить через сайт http://widex.pro/gps-startup-guide, она будет доставлена примерно через 7 календарных дней. Этот документ также доступен на http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Все права защищены

Версия документа: 2.0. Выход: 2019.11