
快速指南

COMPASS GPS

CROS/BICROS

简介

本快速指南旨在为您介绍 CROS/BiCROS 功能。从 HANDLING（操作）窗口左侧的导航栏中选择 CROS/BiCROS。

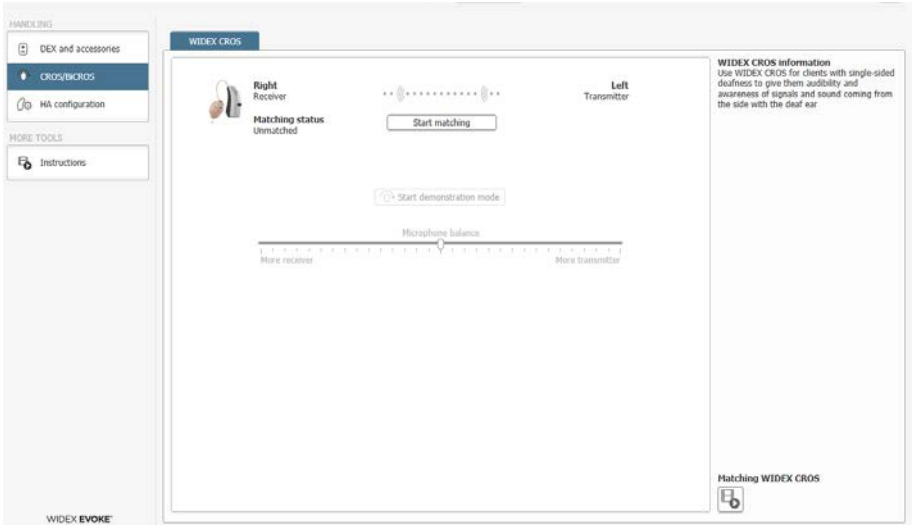

在 CROS 装置中，COMPASS 会基于听力图在助听器中自动生成验配。

在 BiCROS 装置中，您应对助听器接收器执行单耳验配。执行原位测量、Sensogram 及反馈测试，并对助听器进行任何必要的微调。

CROS/BiCROS 窗口

在此窗口中，您可以查看任何 CROS 或 BiCROS 匹配，也可以开始执行新匹配。匹配期间，您可以选择 CROS 或 BiCROS 装置的设置。

匹配流程


此匹配流程类似于 DEX 匹配。注意，您不可在双耳验配中执行 CROS 或 BiCROS 匹配。执行以下操作，在 CROS 或 BiCROS 装置中匹配助听器和 WIDEX CROS：

1. 选择开始匹配按钮。在此按钮旁，您可以看到匹配状态及其他相关信息。
2. 此时会出现一个对话框，在选择类型下方选择 *CROS* 或 *BiCROS*。您可以在屏幕上看到有关不同类型的介绍。
3. 在右侧选择一种麦克风模式。您可以选择定位器或全向性定位器。您可以在屏幕上看到有关不同选项的介绍。
4. 选择*自动激活音频流*应为*开启*或*关闭*。如果*自动激活音频流开启*，当电池舱盖关闭时发射器被打开，音频流自动启动。
5. 选择下一步按钮，开始匹配。 确保助听器和发射器均在编程接口的范围内。随即，匹配开始。
6. 出现匹配完成对话框时，选择确定。

CROS/BiCROS 声音演示

我们建议您在完成助听器与发射器的匹配之后，对 CROS/BiCROS 装置执行声音演示。由此， 您可确保装置正常工作，以及客户听到最优质的声音。

1. 确保助听器接收器及发射器在客户耳部的放置位置正确。
2. 选择 CROS/BiCROS 窗口中部的开始演示模式按钮， 随即对话框出现。此对话框会给您一些有关如何评估声音的提示。请参见右侧的图示。
3. 按下程序按钮，激活发射器。传输激活后，接收器会发出声音。
4. 让客户评估接收器发出的声音。必要时，在 CROS 装置中调整传输声音补偿，或在 BiCROS 装置中调整麦克风平衡。您只能调整与 CROS 或 BiCROS 装置相关的声音。如需整体调整声音，请转至微调主题。
5. 再次按下程序按钮，停止发射器。
6. 选择停止演示模式按钮以返回 CROS/BiCROS 窗口。 发射器只会在演示模式下激活。

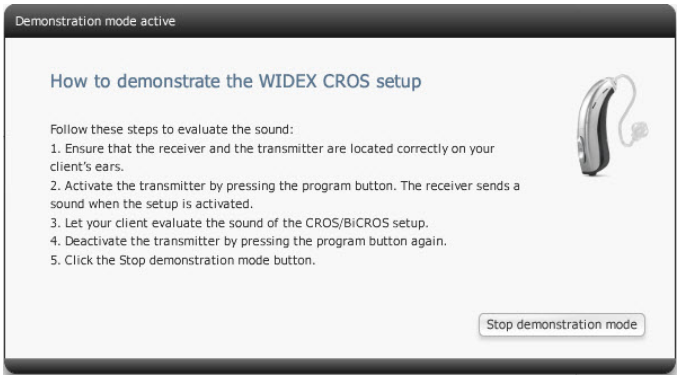

必要时，在 CROS 装置中调整传输声音补偿，或在 BiCROS 装置中调整麦克风平衡，即发射器与接收器之间的声音平衡。 如果您的客户需要整体调整声音， 则使用助听器提供的微调选项。

如果作此调整，您应重新执行上述操作流程，确保音效有所提升。

快速指南

如需了解更多信息及说明，请在 COMPASS 程序中使用顶部导航栏或按键盘上的 F1 按钮，打开帮助系统。

本文件将以电子形式提供。如需获取纸质版，可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 索取，不另行收费，预计交付时间为 7 个日历日。 您也可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 查阅本文件。

© Widex. 版权所有

文件版本：2.0。发布日期　2019-11