
GUIDE RAPIDE

COMPASS GPS

CROS/BICROS

Introduction

Ce guide rapide vous informe sur la fonctionnalité CROS/BiCROS. Sélectionnez CROS/BiCROS depuis la barre de navigation à gauche de la fenêtre GESTION.

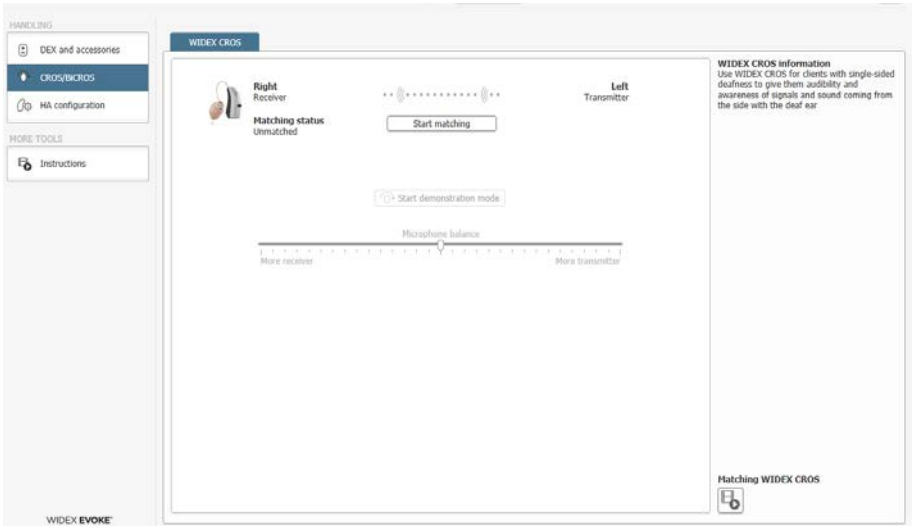

Dans une configuration CROS, COMPASS génère automatiquement une programmation de l'aide auditive à partir de l'audiogramme.

Dans une configuration BiCROS, vous devez faire une programmation monaurale de l'aide auditive réceptrice. Faites les mesures in situ, le Sensogramme et le test du Larsen, puis faites tout ajustement de réglage fin nécessaire dans l'aide auditive.

La fenêtre CROS/BiCROS

Dans cette fenêtre, vous pouvez voir les appairages CROS ou BiCROS, et vous pouvez démarrer un nouvel appairage. Pendant l'appairage, vous pouvez sélectionner les paramètres de la configuration CROS ou BiCROS.

La procédure d’appairage

La procédure d'appairage ressemble à l'appairage d'un DEX. Veuillez noter que vous ne pouvez pas faire d'appairage CROS ou BiCROS lors d'une adaptation binaurale. Faites comme suit pour appairer une aide auditive et un WIDEX CROS dans une configuration CROS ou BiCROS :

1. Sélectionnez le bouton *Démarrer appairage*. À côté de ce bouton, vous pouvez consulter l'état d'appairage et d'autres informations utiles.

2. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez soit *CROS*, soit *BiCROS* sous *Sélectionner type*. Vous pouvez consulter des informations concernant les différents types sur l'écran.

3. À droite, sélectionnez un mode microphone. Vous pouvez choisir entre *Locator* et *Locator omni*. Vous pouvez consulter des informations concernant les options sur l'écran.

4. Précisez si *Activation automatique du streaming* doit être sur *Marche* ou *Arrêt*. Si *Activation automatique du streaming* est sur *Marche*, le streaming démarre automatiquement lorsque l'émetteur est allumé en fermant le tiroir-pile.

5. Sélectionnez le bouton *Suivant* pour démarrer l'appairage. Veillez bien à ce que l'aide auditive et le transmetteur soient dans la portée de l'interface de programmation. L'appairage est désormais en cours.

6. Sélectionnez *OK* lorsque la boîte de dialogue Appairage terminé apparaît.

Démonstration sonore du CROS/BiCROS

Nous recommandons que vous fassiez une démonstration sonore de la configuration CROS/BiCROS lorsque vous aurez appairé l'aide auditive réceptrice et le transmetteur. De cette façon, vous pourrez vous assurer que la configuration fonctionne correctement et que votre patient reçoit le meilleur son possible.

1. Veillez à ce que l'aide auditive réceptrice et le transmetteur soient correctement placés sur les oreilles de votre patient.

2. Sélectionnez le bouton *Démarrer le mode de démonstration* au milieu de la fenêtre CROS/BiCROS. Une boîte de dialogue apparaît. Cette boîte de dialogue vous donne des astuces sur la façon d'évaluer le son. Voir l'illustration à droite.



3. Activez le transmetteur en appuyant sur le bouton de sélection des programmes. Le récepteur envoie un son lorsque la transmission est activée.

4. Laissez votre patient évaluer le son. Si nécessaire, ajustez le *Son transmis par défaut* (dans une configuration CROS) ou l'*Équilibre du microphone* (dans une configuration BiCROS). Vous pouvez uniquement ajuster le son relatif à la configuration CROS ou BiCROS. Allez à la rubrique Réglage fin si vous avez besoin d'ajuster davantage le son.

5. Désactivez le transmetteur en appuyant de nouveau sur le bouton de sélection des programmes.

6. Sélectionnez le bouton *Arrêter le mode de démonstration* pour retourner à la fenêtre CROS/BiCROS. Le transmetteur est uniquement actif pendant le mode de démonstration.

Ce document est fourni sous forme électronique. Vous pouvez faire la demande d'une version papier gratuitement sur http://widex.pro/gps-startup-guide. Délai de livraison estimé à 7 jours ouvrés. Le document est désormais disponible sur http://widex.pro/gps-startup-guide.

Pour plus d'informations et de conseils, ouvrez le Système d'aide depuis la barre de navigation du programme COMPASS ou appuyez sur le bouton F1 de votre clavier.

© Widex. Tous droits réservés

Version du document : 2.0 . Publié : 2019-11