
QUICK GUIDE

COMPASS GPS

CROS/BICROS

Introduktion

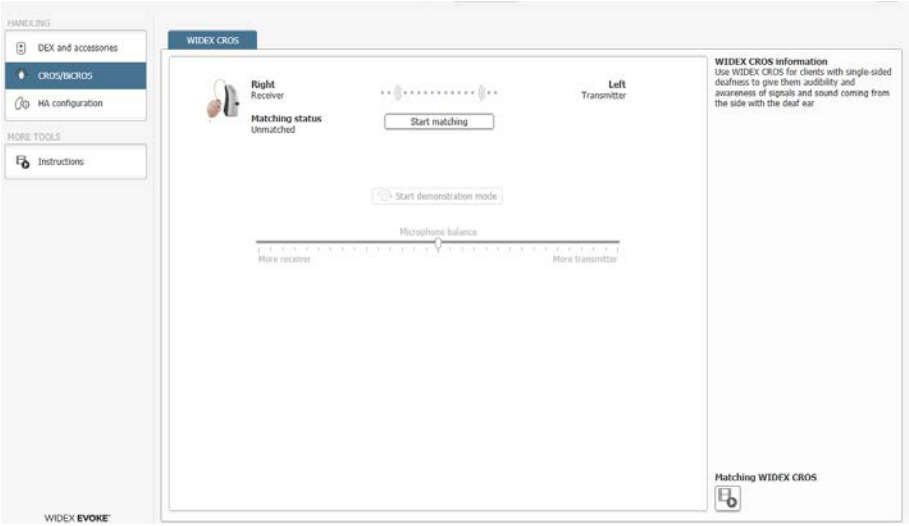

Denne quick guide oplyser dig om funktionen CROS/BiCROS. Vælg CROS/BiCROS i navigationsbjælken til venstre i vinduet HÅNDTERING.

I en CROS opsætning genererer COMPASS automatisk en tilpasning i høreapparatet på basis af audiogrammet.

I en BiCROS opsætning skal du foretage en monaural tilpasning af det modtagende høreapparat. Udfør in-situ målinger, Sensogram og måling af Feedback, og foretag om nødvendigt finjusteringer i høreapparatet.

Vinduet CROS/BiCROS

I dette vindue kan du se eventuelle CROS og BiCROS matchninger, og du kan starte en ny matchning. Under matchningen kan du vælge indstillinger for CROS eller BiCROS opsætning.

Matchningen

Matchningen ligner matchningen for DEX. Bemærk, at du ikke kan foretage en CROS eller BiCROS matchning i en binaural tilpasning. Gør følgende for at matche et høreapparat og et WIDEX CROS i en CROS eller BiCROS opsætning.

1. Tryk på knappen *Start matchning*. Ved siden af knappen kan du se matchstatus og andre relevante oplysninger.

2. Vælg enten *CROS* eller *BiCROS* under *Vælg type* i den dialogboks, der vises. Du kan se oplysninger om de forskellige typer på skærmen.

3. Til højre skal du vælge en mikrofonindstilling. Du kan vælge mellem *Locator* og *Locator Omni.* Du kan se oplysninger om dine valgmuligheder på skærmen.

4. Vælg, om *Autoaktivér streaming* skal være slået *Til* eller *Fra*. Hvis *Autoaktivér streaming* er slået *Til*, starter streaming automatisk, når transmitteren tændes ved at lukke batteriskuffen.

5. Klik på knappen *Næste* for at starte matchningen. Sørg for, at høreapparatet og transmitteren er inden for programmeringsinterfacets rækkevidde. Matchningen er nu i gang.


6. Vælg *OK*, når dialogboksen Matchning afsluttet vises.

CROS/BiCROS lyddemonstration

Vi anbefaler, at du gennemfører en lyddemonstration med CROS/BiCROS opsætningen, når du har matchet transmitteren og det modtagende høreapparat. På den måde kan du sikre, at opsætningen fungerer korrekt, og at klienten får den optimale lyd.

1. Sørg for, at det modtagende høreapparat og transmitteren er placeret korrekt i brugerens øre.

2. Vælg knappen *Start demonstrationstilstand* i midten af vinduet for CROS/BiCROS. Herefter åbnes en dialogboks. Dialogboksen giver dig nogle tips til at evaluere lyden. Se illustrationen til højre.

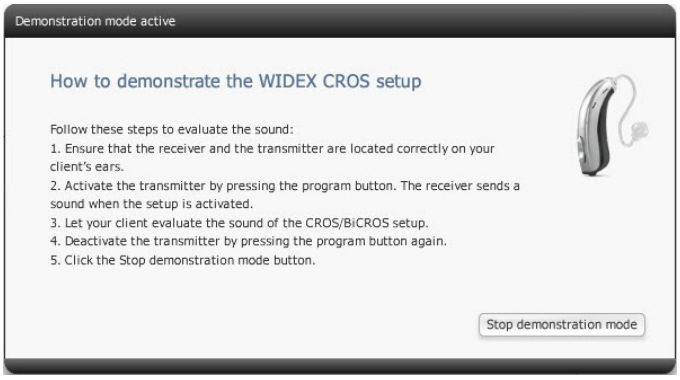

3. Aktiver transmitteren ved at trykke på programknappen. Højttaleren afspiller en lyd, når streaming aktiveres.

4. Lad klienten vurdere lyden. Foretag om nødvendigt justeringer i *Transmitteret lydstyrkejustering* (i en CROS opsætning) eller *Mikrofonbalance* (i en BiCROS opsætning). Du kan kun justere lyden, der er relateret til CROS eller BiCROS opsætningen. Gå til emnet Finjustering, hvis du vil foretage mere generelle lydjusteringer.

5. Deaktiver transmitteren ved at trykke på programknappen igen.

6. Vælg knappen *Stop demonstrationstilstand* for at vende tilbage til vinduet CROS/BiCROS. Transmitteren er kun aktiv under demonstrationstilstand.

Du kan få mere information og vejledning ved at åbne Hjælp-systemet fra øverste navigationsbjælke i COMPASS programmet eller ved at trykke på F1-knappen på tastaturet.

Dette dokument leveres i elektronisk form. En papirudgave af vejledningen kan bestilles uden ekstra omkostninger på http://widex.pro/gps-startup-guide. Forventet leveringstid: 7 kalenderdage. Dokumentet findes også på http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Alle rettigheder forbeholdes

Dokumentversion: 2.0. Udstedt: 2019-11