
KISA KILAVUZ

COMPASS GPS

CROS/BİCROS

Giriş

Bu kısa kılavuzda CROS/BiCROS işleviyle ilgili bilgi verilmektedir. KULLANIM penceresinin sol tarafından CROS/BiCROS seçeneğini seçin.

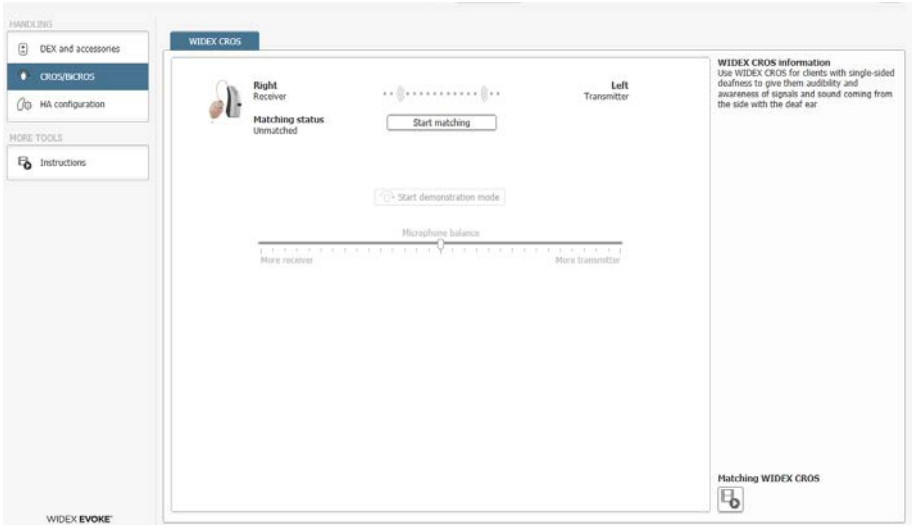

CROS kurulumunda, COMPASS odyograma bağlı olarak işitme cihazında bir uygulama oluşturur.

BiCROS kurulumunda, alıcı işitme cihazı için tek kulakta uygulama yapmanız gerekir. Yerleşik ölçümler, Sensogram ve Geribesleme testini ve gerekirse işitme cihazında ince ayarlamaları yapın.

CROS/BiCROS penceresi

Bu pencerede CROS ve BiCROS eşlemelerini görebilir veya yeni bir eşleştirme yapabilirsiniz. Eşleştirme işlemi sırasında CROS veya BiCROS kurulumunda değişiklikler yapılabilir.

Eşleştirme işlemi

Eşleştirme işlemi DEX eşleştirmesine benzerdir. İki kulak uygulamasında CROS veya BiCROS eşleştirme yapılamaz. CROS veya BiCROS kurulumunda, bir işitme cihazı ile WIDEX CROS'u eşleştirmek için aşağıdakiler yapılmalıdır:

1. Eşleştirmeyi başlat seçeneğini seçin. Bu tuşun yanında eşleştirme durumu ve diğer bilgiler görüntülenir.

2. Açılan iletişim kutusundan Tipi seçin başlığı altında CROS veya BiCROS seçeneğini seçin. Yaptığınız seçim hakkındaki bilgiler ekranda görüntülenir.

3. Sağ taraftan mikrofon modunu seçin. Konumlandırıcı ve Konumlandırıcı Yönlenmesiz seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Yaptığınız seçim hakkındaki bilgiler ekranda görüntülenir.

4. *Aktarımı otomatik başlat* için açık ya da kapalı seçeneğini seçin. Eğer *Aktarımı otomatik başlat* seçeneği *Açık* ise, vericinin pil yuvası kapatılarak açılmasıyla birlikte aktarım otomatik olarak başlar.

5. Eşleştirmeyi başlatmak için İleri seçeneğini seçin. İşitme cihazı ve vericinin programlama arayüzünün kapsama alanında olduğundan emin olun. Eşleştirme başlamıştır.

6. Eşleştirme tamam iletişim kutusu görüldüğünde Tamam seçeneğine tıklayın.

CROS/BiCROS ses denemesi

Alıcı işitme cihazı ile vericiyi eşledikten sonra CROS/BiCROS kurulumu ile ilgili bir ses denemesi yapmanız önerilir. Böylelikle, kurulumun doğru yapıldığını ve hastanıza en uygun sesin sunulduğundan emin olabilirsiniz.

1. Alıcı işitme cihazı ve vericinin hastanızın kulaklarına doğru yerleştirildiğinden emin olun.

2. CROS/BiCROS penceresinin orta kısmında yer alan Demo modunu başlat tuşunu tıklayın, bir iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunda sesi nasıl değerlendirebileceğiniz konusunda bazı ipuçları bulunur. Sağdaki şekli inceleyiniz.



3. Program tuşuna basarak vericiyi açın. Aktarım başladığında alıcı cihaz bir ses üretir.

4. Hastanızdan sesi değerlendirmesini isteyin. Gerekirse, Aktarılan ses dengesi (CROS kurulumunda) veya Mikrofon dengesi (BiCROS kurulumunda) için ayarlama yapın. Yalnızca CROS veya BiCROS kurulumu ile ilgili sesi ayarlayabilirsiniz. Sesle ilgili genel ayarlamalar için İnce Ayar penceresine gitmeniz gerekir.

5. Tekrar program tuşuna basarak vericiyi kapatın.

6. CROS/BiCROS penceresine dönmek için Demo modunu durdur seçeneğine tıklayın. Verici yalnızca deneme modunda çalışır.

Bu belge elektronik ortamda sunulmaktadır. Bu belgenin basılı formunu http://widex.pro/gps-startup-guide adresinden ücretsiz olarak talep edebilirsiniz, tahmini gönderim süresi 7 takvim günüdür. Bu belgeyi http://widex.pro/gps-startup-guide adresinde de bulabilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi ve yönlendirme için, COMPASS yazılımındaki üst gezinme çubuğuna tıklayarak ya da klavyenizde F1 tuşuna basarak Yardım sistemini açın.

© Widex. Tüm hakları saklıdır

Belge sürümü: 2.0. Yayınlanma: 2019-11