퀵 가이드

COMPASS GPS

보청기 인식하기

소개


본 퀵가이드는 COMPASS 에서 보청기를 인식 및 연결하는 과정에 대하여 설명합니다. 모든 보청기는 피팅을 진행하기 이전에 무선상태에서 정상적으로 인식 및 연결되어 있어야 합니다.

보청기의 연결

보청기를 인식 및 연결하는 방법은 아래와 같습니다 :

1. 데이터베이스에서 해당고객을 선택하고 COMPASS 를 실행합니다.

2. '세션 시작' 또는 '선택' 창의 메인 작업공간 상단에서 드롭다운 리스트를 눌러 인터페이스 장치를 선택합니다. 기본 선택은 가장 최근에 사용했던 인터페이스 장치입니다. 표시되는 인터페이스 장치의 수는 이전에 연결했던 장치에 따라 다릅니다.

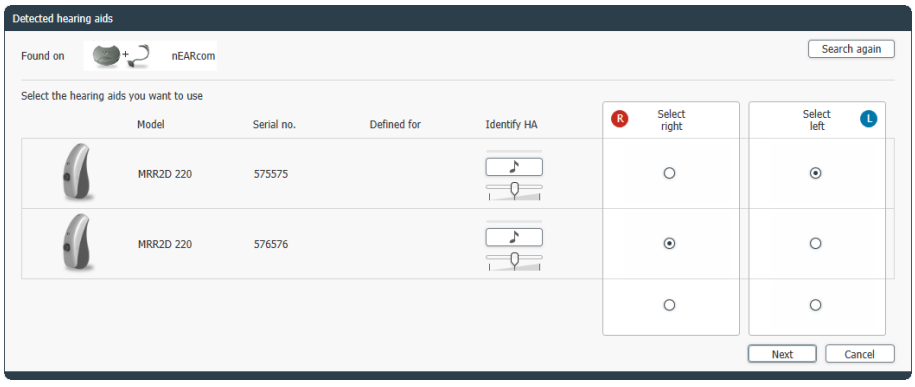

3. '세션 시작' 또는 '선택' 창에서 화면상단의 '연결' 버튼을 클릭합니다.

   COMPASS 가 작동거리 내에 있는 모든 보청기를 탐색하여 대화상자에 이를 표시합니다.

퀵 가이드

4. 무선 인터페이스장치 가까이에 전원이 켜진 보청기가 둘 이상일 경우 좌우 귀에 맞는 정확한 보청기 인식이 어려울 수 있습니다. 인식된 보청기를 정확히 확인하려면 *보청기 확인* 바로 아래에 있는 음표 모양의 *재생* 버튼을 사용하십시오. *재생* 버튼을 클릭하면 해당 보청기에서 소리가 나므로 어느 쪽의 보청기가 반응하는지 정확히 확인할 수 있습니다. f

5. *우측 선택, 좌측 선택* 열의 라디오버튼을 선택하여 각 보청기의 좌우 사용을 지정합니다.

6. 보청기 모델 선택이 완료되었으면 *다음*을 선택하여 진행합니다. 연결상태를 표시하는 대화상자가 나타납니다. 이 화면에서 보청기모델, 제품번호 및 보청기의 옵션이 표시됩니다.



7. 드롭다운 리스트를 사용하여 이어웨어 (EarWare)를 선택 또는 변경합니다. 실제 고객이 사용하는 이어셋과 반드시 일치하도록 선택하십시오. 그렇지 않은 경우 피팅 데이터가 정확하게 반영되지 않아 고객이 보청기로부터 제대로 효과를 볼 수 없게 됩니다.

8. *다음*을 선택하면 보청기가 연결된 상태가 됩니다. 연결상태에서는 '연결' 버튼이 '연결해제' 버튼으로 바뀝니다.

추가 정보와 설명이 필요하신 경우 COMPASS 프로그램의 상단 바에 있는 도움말 기능을 열거나 키보드의 F1 키를 누르시기 바랍니다.

이 문서는 전자형태로 제공됩니다. 이 설명서의 종이 버전은 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서 무상으로 요청하실 수 있으며 배송은 영업일 기준 7 일 정도 소요됩니다. 이 문서는 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서도 제공됩니다.

Copyright © Widex. All rights reserved.

Document version: 2.0. Issue date: 2019-11