
QUICK GUIDE

COMPASS GPS

FIJNREGELING

Inleiding

Deze quick guide behandelt het thema FIJNREGELING van COMPASS GPS. In dit thema hebt u toegang tot de Programmastarter en de primaire fijnregelopties: Programma-instellingen en de Programma manager. Onder Meer Mogelijkheden hebt u toegang tot een aantal andere opties.

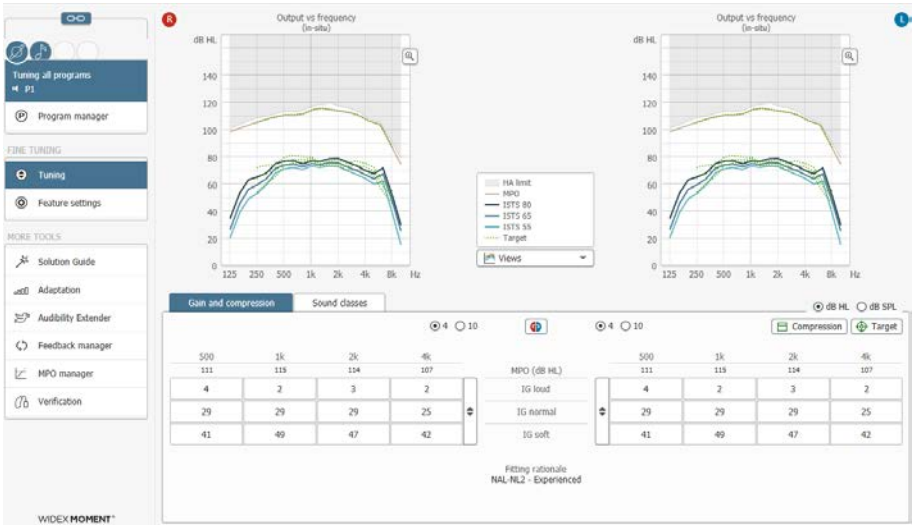

Programmastarter

De Programmfastarter staat bovenaan de linker navigatiebalk. Het hoogste aantal programma's is vijf, plus een SmartToggle programma. Staat er meer dan één programma in de hoortoestellen, dan ziet u niet alle namen van de gekozen programma's – maar alleen de naam van het actieve programma. De overige programma's worden aangegeven met programma-symbolen en de betreffende namen worden weergegeven als u de muispijl op het betreffende symbool houdt.

Die features die u onder Fijnregeling ter beschikking hebt verschillen, afhankelijk van welk hoortoestel u hebt gekozen. Hieronder vindt u een omschrijving van de mogelijkheden voor zowel de DREAM- als de UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT-hoortoestellen.

Primaire fijnregelmogelijkheden UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT-hoortoestellen

- **Programma manager**: het aantal beschikbare programma's hangt af van het type toestel en of er een DEX bij de hoortoestellen wordt gebruikt. In de fabrieksinstelling bevatten de meeste

hoortoestellen één programma, het Universele programma. Echter, sommige typen hoortoestellen (bijv. toestellen met een Bluetooth-verbinding), bevatten meer dan één automatisch progrmma. In de Programma manager kunt u extra programma's toevoegen.

Gebruik de *Additionele programma's* als uw cliënt een programma nodig heeft voor een speciale geluidsomgeving, bijv. om naar muziek te luisteren. Gebruik de *Speciale programma's* als uw cliënt een telefoonprogramma nodig heeft of als hij een luisterspoelprogramma of een Zen-programma wil.

Ook kunt u een *SmartToggle*-programma toevoegen. Kies hiervoor uit Zen+ zodat uw cliënt kan kiezen uit 3 verschillende Zen-stijlen of kies het Phone+programma zodat uw cliënt een telefoongesprek via beide hoortoestellen kan horen.

- **Tuning**: In dit scherm hebt u altijd de beschikking over het tabblad *Gain en compressie*, waarin u de insertion gain en de compressie van het hoortoestel kunt aanpassen. Standaard wordt in dit scherm de grafiek Output vs Frequentie weergegeven. U kunt echter andere grafieken selecteren. Gebruik hiervoor de opties die u tussen de beide grarfieken vindt.

  Naast het tabblad *Gain en compressie* hebt u toegang tot andere tabbladen, afhankelijk van het hoortoestel en de gekozen programma's. U kunt bijv. de instellingen van de Sound class in het Universele programma wijzigen en in het Zen+programma kunt u werken met de keuze van de Zen-stijl en opties.

- **Feature-instellingen**: In dit scherm hebt u toegang tot een aantal verschillende instelmogelijkheden, bijv. de Spraak- en lawaaimodus, de Windruisonderdrukking en de Feedback cancelling modus. Van elke feature kunt u de huidige instelling zien en door op het icoon van een feature te klikken krijgt u een dialoogvenster waarin u de instelling kunt veranderen en waarin informatie over het feature wordt weergegeven.

Primaire fijnregelmogelijkheden DREAM hoortoestellen

- **Programma-instellingen**: Standaard wordt in dit scherm de grafiek Output vs Frequentie weergegeven. U kunt echter andere grafieken selecteren. Gebruik hiervoor de opties die u tussen de beide grarfieken vindt.


  Gebruik de tabs onder de grafieken om de instellingen in het hoortoestel te veranderen. Gebruik het tabblad Instellingen versterking om deze aan te passen voor verschillende frequentiegebieden en ingangsniveaus. Gebruik de tab Compressie om de CT1 (compressiedrempel) aan te passen en de CT2 te bekijken, net als de CR1- en CR2-waarden (compressieratio). Gebruik de tab Instellingen functies om de instellingen van bepaalde functies te wijzigen.

- **Programma manager**: het aantal beschikbare programma's hangt af van het type toestel en of er een DEX bij de hoortoestellen wordt gebruikt. Af fabriek bevatten alle hoortoestellen één programma; het Master programma. In de Programma manager kunt extra programma's toevoegen.

  Gebruik Normale programma's om bij een binaurale aanpassing hetzelfde programma in beide hoortoestellen te zetten. Wilt u verschillende programma's in de hoortoestellen, kies dan voor Combinatieprogramma's en maak uw keuze uit de lijst.

Meer mogelijkheden

MEER MOGELIJKHEDEN omvat de volgende opties::

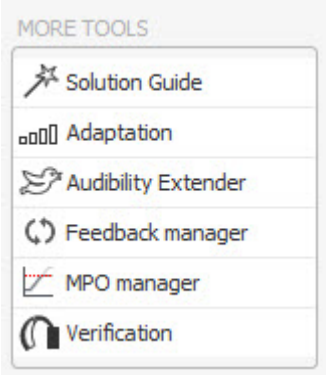

- **Oplossingengids.** De Oplossingengids Algemeen gaat over de algemene werking van het hoortoestel. Opent u de Oplossingengids vanuit het Master-programma, dan is dit de Oplossingengids Algemeen. Alle wijzigingen van de aanpassing worden toegepast op alle programma's van het hoortoestel. Opent u de Oplossingengids vanuit een ander luisterprogramma, dan is dit de Oplos-singengids Specifiek en worden wijzigingen uitsluitend in het betreffende programma aangebracht. De Oplossingengids maakt gebruik van informatie over uw cliënt en de hoortoestel-aanpassing die in Compass is opgeslagen om zowel cliëntspecifieke als algemene suggesties te doen. De meeste hiervan kunt u direct vanuit de Oplossingengids activeren.

- **Adaptatie**. Is uw cliënt niet gewend om hoortoestellen te dragen, dan kunt u de optie Adaptatie voor een bepaalde periode instellen op een niveau lager dan 4. Hiermee wordt de algehele versterking gereduceerd. Is de cliënt gewend, dan kan het Adaptatieniveau terug naar niveau 4. U kunt ook kiezen voor Automatische adaptatie, dan wordt het niveau automatisch gewijzigd. Adaptatie is een algemene feature, dat betekent dat alle programma’s in het hoortoestel worden beïnvloed. Als grafiek ziet u Output vs. frequentie, inclusief de doelcurves.

- **Audibility Extender**. Opent u de Audibility Extender, dan wordt automatisch het Master-programma geopend. Voor UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT-hoortoestellen blijft het laatst gekozen programma actief. In de grafische weergave ziet u het effect van de Audibility Extender. Het scherm Audibility Extender opent in de tab Gekozen programma’s. Hier kunt u aangeven in welke programma’s de Audibility Extender actief moet zijn. U kunt voor alle of voor specifieke prgramma’s kiezen. Ook kunt u de instellingen beïnvloeden – kies de Beginfrequentie en het frequentiebereik. Bij sommige hoortoestellen kunt u ook het volume van de Audibility Extender bepalen en adaptatie voor de Audibility Extender inschakelen.

- **Feedback manager.** Zelfs als de terugkoppelingstest voldoende was, kan uw cliënt klagen over fluitende hoortoestellen, met name in een rustige omgeving en dat betekent dat terugkoppeling nog wel aanwezig kan zijn. Helpen het maken van een nieuw oorstukje en/of het verkleinen van de ontluchting niet voldoende, dan kunt u proberen om het probleem op te lossen met behulp van Feedback manager

- **MPO Manager**. Het scherm MPO manager toont de target MPO-waarden en, voor DREAM-hoortoestellen, de referentiewaarden ter informatie. U kunt de niveau’s van de maximum power output levels bepalen. Wijzigingen beïnvloeden alle programma’s in het hoortoestel.

- **Verificatie**. Met deze feature kan het hoortoestel worden ingesteld voor verificatiemetingen met behulp van een extern hoortoestel-analysesysteem. U kunt kiezen uit de Normale adaptieve teststand en de Niet-adaptieve teststand.

Open voor meer informatie het Help-systeem in de bovenste navigatiebalk in Compass, of door te drukken op F1 op uw toetsenbord.Dit Help-systeem is Engelstalig.

Dit document wordt aangeboden in elektronische vorm. Een papieren versie kan gratis worden opgevraagd op http://widex.pro/gps-startup-guide, de verwachte leveringstijd bedraagt 7 kalenderdagen. Het document is tevens beschikbaar op http://widex.pro/gps-startup-guide.

Copyright © Widex. Alle rechten voorbehouden.

Documentversie 2.0. Uitgave: 2019-11.