
QUICK GUIDE

COMPASS GPS

FINJUSTERING

Introduktion

Denne quick guide omhandler FINJUSTERING i COMPASS. Emnet giver dig adgang til både Programstarter og de primære værktøjer til FINJUSTERING, som du kan bruge til at foretage basisændringer i systemet. Under FLERE VÆRKTØJER har du adgang til en yderligere række nyttige værktøjer.

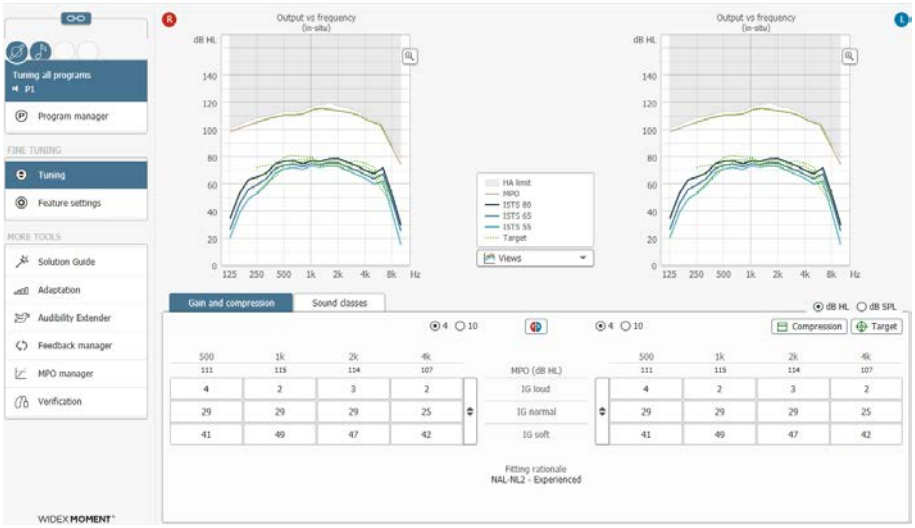

Programstarter

Programstarter er placeret øverst på venstre navigationsbjælke, og der er højst fem programmer til rådighed, plus et SmartToggle program. Når du har flere programmer end ét i høreapparaterne, kan du ikke se navnene på alle programmerne – kun på det program, der er aktivt. De andre programmer præsenteres ved programikoner. Programnavne vises, når du holder musen hen over ikonet.

Bemærk, at de tilgængelige funktioner under Finjustering afhænger af, hvilke høreapparater du arbejder med. Nedenfor kan du både se en beskrivelse af værktøjerne til finjustering af DREAM høreapparater og en beskrivelse af værktøjerne til UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT høreapparater.

Primære værktøjer til UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT høreapparater

- **Program manager**: Det antal programmer, et høreapparat kan indeholde, afhænger af modellen og af, om en DEX anvendes med høreapparatet. Fra fabrikken indeholder de fleste høreapparater ét

program – Universal-programmet. Visse typer høreapparater (f. eks. høreapparater med Bluetooth-tilslutning) indeholder dog mere end ét automatisk defineret program. Ved hjælp af Program manager kan du definere yderligere programmer.

Brug *Flere programmer*, hvis klienten har behov for et program til et specielt lydmiljø, f.eks. til at lytte til musik. Brug *Specielle programmer*, hvis klienten har brug for et Telefon-program, bruger telespole alene eller sammen med mikrofonen, eller hvis klienten ønsker et Zen-program til afslapning.

Du kan også tilføje et *SmartToggle* program. Du kan enten vælge Zen+ for at give klienten tre forskellige Zen lydstile at vælge mellem eller vælge Telefon+, hvis klienten ønsker nem adgang til et telefonprogram.

- **Justering** I dette vindue har du altid adgang til fanen *Forstærkning og kompression*, hvor du kan justere niveauerne for Insertion Gain og kompression i høreapparatet. Standardgrafikvisning i vinduet Justering er Output vs. frekvens-visningen. Du kan også vælge andre grafikvisninger. Anvend mulighederne mellem de to grafiske repræsentationer til at skifte visning.

  Ud over fanen *Forstærkning og kompression* kan du have adgang til andre faner, afhængigt af høreapparatet og det valgte program. I Universal programmet kan du f.eks. justere lydklasseindstillingerne, og i Zen+ programmet kan du arbejde med valg og indstillinger af Zen+ stil.

- **Funktionsindstillinger** Dette vindue giver dig adgang til en række forskellige indstillingsmuligheder, f.eks. Tale- og støjindstilling, Dæmpning af vindstøj og Feedback Cancelling. Du kan se den aktuelle indstilling for hver funktion i oversigten, og ved at klikke på et funktionsikon får du adgang til en dialogboks, hvor du kan ændre indstillingen og læse mere om funktionen.

Primære værktøjer til DREAM høreapparater

- **Programindstillinger:** Standardgrafikvisningen er Output vs. frekvens. Du kan imidlertid vælge andre grafikvisninger. Anvend mulighederne mellem de to grafiske repræsentationer til at skifte visning.


  Anvend fanerne under grafikken til at justere indstillingerne i høreapparaterne. Fanen *Forstærkningsindstillinger* gør det muligt at justere forstærkningen for forskellige frekvensområder og inputniveauer, og fanen *Kompression* gør det muligt at justere CT1 (kompressionstærskel) og få vist værdierne for CT2, CR1 og CR2 (kompressionsforhold). Anvend fanen *Funktionsindstillinger* til at definere indstillingerne for nogle af de specielle funktioner i høreapparaterne.

- **Program manager**: Det antal programmer, et høreapparat kan indeholde, afhænger af modellen og af, om en DEX anvendes med høreapparatet. Fra fabrikken indeholder høreapparatet ét program – Master programmet. Ved hjælp af Program manager kan du definere yderligere programmer.

  Anvend Normal-programmer til at tilføje det samme program i begge høreapparater ved en binaural tilpasning. Hvis du har brug for forskellige programmer i de to høreapparater, skal du vælge Programkombinationer og derefter vælge fra listen over programkombinationer.

Flere værktøjer til rådighed

FLERE VÆRKTØJER indeholder følgende nyttige værktøjer:

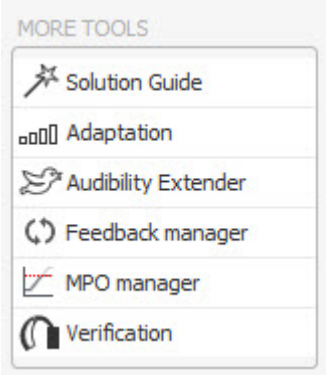

- **Løsningsguide** Global løsningsguide arbejder generelt med høreapparaternes funktionalitet. Hvis du åbner Løsningsguiden fra hovedprogrammet, er Global løsningsguide aktiv, og de ændringer i tilpasningen, du eventuelt foretager, vil få indflydelse på alle programmer i høreapparatet. Hvis du åbner Løsningsguiden fra et andet program end hovedprogrammet, er Programspecifik løsningsguide aktiv og hjælper dig med kun at justere det pågældende program. Løsningsguiden anvender oplysninger om din klient og om det høreapparat, der er lagret i COMPASS, til at give forslag til både klientspecifikke og mere generelle løsninger. Du kan anvende de fleste løsninger direkte fra Løsningsguiden.

- **Tilvænning**. Hvis din klient ikke er vant til at bruge høreapparater, kan du i en periode indstille funktionen Tilvænning til et lavere niveau end 4. Det reducerer forstærkningen generelt. Når klienten bliver vant til høreapparaterne, kan du sætte funktionen Tilvænning tilbage til niveau 4. Automatisk tilvænning er også tilgængelig – her ændres niveauet automatisk. Tilvænning er en global funktion, hvilket betyder, at den dækker alle de programmer, der er defineret i høreapparatet. Grafikken viser Output vs. frekvens inklusive target-kurver.

- **Audibility Extender** Når du åbner Audibility Extender for DREAM høreapparater, føres du automatisk til hovedprogrammet. For UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT høreapparater forbliver det tidligere valgte program aktivt. Grafikvisningen viser effekten af Audibility Extender. Vinduet Audibility Extender åbner i fanen Valgte programmer. Her kan du vælge de programmer, hvor du ønsker, Audibility Extender skal være aktiv. Du kan slå funktionen til for enten alle eller for specifikke programmer i høreapparaterne. Du kan definere indstillingerne – vælg Startfrekvens for funktionen og vælg det Frekvensområde, Audibility Extender skal arbejde med. For visse høreapparater kan du også definere lydstyrken for Audibility Extender og slå tilvænning til for Audibility Extender.

- **Feedback Manager** Selv hvis du gennemfører en vellykket feedback-test, kan klienten klage over, at høreapparatet fløjter, især i stille omgivelser, hvilket vil sige, at der stadig er feedback. Hvis det ikke hjælper klienten, at du fremstiller en ny øreprop og reducerer ventilationsstørrelsen, kan du måske løse problemet ved at foretage justeringer i Feedback Manager.

- **MPO Manager** Vinduet MPO manager viser MPO-værdier og (for DREAM høreapparater) referenceværdier til din orientering. Du kan definere niveauerne for Maximum Power Output. Bemærk, at justeringer til denne funktion får indflydelse på alle programmer i høreapparatet.

- Denne funktion indeholder værktøjer, som kan anvendes til at indstille høreapparatet til verifikationsmålinger med et eksternt analysesystem til høreapparater. Du kan vælge mellem den normale adaptive testindstilling og den non-adaptive testindstilling.

Du kan få mere information og vejledning ved at åbne Hjælp-systemet fra øverste navigationsbjælke i COMPASS programmet eller ved at trykke på F1-knappen på tastaturet.

Dette dokument leveres i elektronisk form. En papirudgave af vejledningen kan bestilles uden ekstra omkostninger på http://widex.pro/gps-startup-guide. Forventet leveringstid: 7 kalenderdage. Dokumentet findes også på http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Alle rettigheder forbeholdes

Dokumentversion: 2.0. Udstedt: 2019-11