
GUIDE RAPIDE

COMPASS GPS

LE RÉGLAGE FIN

Introduction

Ce guide rapide vous explique le fonctionnement de la rubrique RÉGLAGE FIN dans COMPASS. Cette rubrique vous donne accès au Démarreur de programmes, ainsi qu'aux principaux outils de RÉGLAGE FIN avec lesquels vous pouvez effectuer des changements de base au système. Sous PLUS D'OUTILS vous pouvez accéder à un ensemble d'outils utiles supplémentaires.

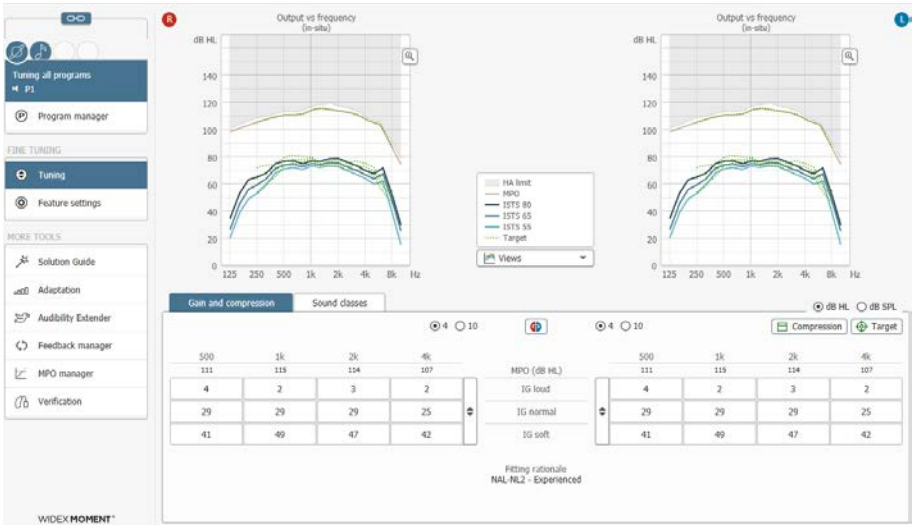

Le Démarreur de programmes

Le Démarreur de programmes se trouve en haut de la barre de navigation gauche. Le nombre le plus élevé de programmes est cinq, plus un programme SmartToggle. Lorsque les aides auditives possèdent plusieurs programmes, vous ne pouvez pas voir les noms de chacun des programmes. Vous ne verrez que celui du programme actif. Les autres programmes sont représentés par les icônes des programmes. Les noms des programmes s'affichent lorsque vous pointez le curseur de votre souris sur l'icône.

Veuillez noter que les fonctionnalités disponibles sous Réglage fin diffèrent selon les aides auditives avec lesquelles vous travaillez. Ci-dessous, vous trouverez une description des outils de Réglage fin pour les aides auditives DREAM et une description des outils pour les aides auditives UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT.

Les principaux outils pour les aides auditives UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT

- **Gestionnaire de programmes** : Le nombre de programmes que peut contenir une aide auditive dépend du modèle, mais également du fait que l'aide auditive est utilisée ou non avec un appareil DEX. Au départ de l'usine, la plupart des aides auditives sont dotées d'un programme, le programme Universel. Cependant, certains types d'aides auditives (par exemple, les aides auditives avec une connexion Bluetooth) comprennent automatiquement deux ou plusieurs programmes prédéfinis. Le Gestionnaire de programmes vous permet de définir des programmes supplémentaires.

  Utilisez les *Programmes supplémentaires* si votre patient a besoin d'un programme pour un environnement sonore particulier, par exemple pour écouter de la musique. Utilisez les *Programmes spéciaux* si votre patient a besoin d'un programme Téléphone ou s'il utilise la bobine téléphonique seule ou avec le microphone, ou si votre patient veut un programme Zen pour la relaxation.

  Vous pouvez également ajouter un programme *SmartToggle*. Sélectionnez soit Zen+ pour permettre à votre patient de choisir parmi trois harmonies Zen différentes, soit Téléphone+ si votre patient a besoin d'accéder facilement à un programme pour téléphone.

- **Réglage** : De cette fenêtre, vous avez toujours accès à l'onglet *Gain et compression* sous lequel vous pouvez ajuster les niveaux du gain d'insertion et la compression de l'aide auditive. L'affichage graphique par défaut de la fenêtre Réglage est l'affichage Sortie/Fréquence. Cependant, vous pouvez sélectionner d'autres affichages. Pour changer l'affichage, utilisez les options des deux représentations graphiques.

  Outre l'onglet *Gain et compression*, vous pouvez accéder à d'autres onglets selon l'aide auditive et le programme sélectionné. Par exemple, vous pouvez ajuster les Réglages des classes de sons du programme Universel, et dans le programme Zen+, vous pouvez travailler avec la sélection et les options d'harmonie Zen+.

- **Réglages des fonctionnalités** : Cette fenêtre vous donne accès à différentes possibilités de réglage, par exemple, le Traitement de la parole et du bruit, l'Atténuation du bruit causé par le vent et le mode de Suppression du Larsen. Pour chaque fonctionnalité, vous pouvez consulter le réglage actuel dans la vue générale. En cliquant sur l'icône de la fonctionnalité, vous avez accès à une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez changer le réglage et en lire plus sur la fonctionnalité.

Les principaux outils pour les aides auditives DREAM

- **Les réglages du programme** : L'affichage graphique par défaut est l'affichage Sortie/Fréquence. Cependant, vous pouvez sélectionner d'autres affichages graphiques. Pour changer l'affichage, utilisez les options des deux représentations graphiques.


  Pour ajuster les réglages des aides auditives, utilisez les onglets sous les graphiques. L'onglet *Réglages du gain* vous permet d'ajuster l'amplification des différentes régions fréquentielles et des niveaux d'entrées. L'onglet *Compression* vous permet d'ajuster le CT1 (Seuil de compression) et d'afficher les valeurs CT2, CR1 et CR2 (Rapport de compression). Pour définir les réglages de certaines fonctionnalités des aides auditives, utilisez l'onglet *Réglages caractéristiques*.

- **Gestionnaire de programmes** : Le nombre de programmes que peut contenir une aide auditive dépend du modèle, mais également du fait que l'aide auditive est utilisée ou non avec un appareil DEX. Au départ de l'usine, toutes les aides auditives comprennent un programme, le programme Principal. Le Gestionnaire de programmes vous permet de définir des programmes supplémentaires.

  Utilisez Programmes normaux pour ajouter le même programme dans les deux aides auditives d'un appareillage binaural. Si vous avez besoin de différents programmes dans les deux aides auditives, sélectionnez Programmes composés, puis choisissez une combinaison de programmes dans la liste.

Plus d'outils disponibles

PLUS D'OUTILS contient les outils suivants :

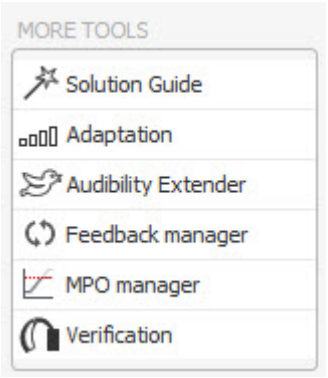

- **Guide de solutions.** Le guide de solutions global travaille avec la performance générale des aides auditives. Si vous ouvrez le Guide de solutions depuis le programme principal, le Guide de solutions global est actif et tout changement apporté à la programmation affecte tous les programmes de l'aide auditive. Si vous ouvrez le Guide de solutions depuis un autre programme que le programme principal, le Guide de solutions spécifique au programme s'ouvre et vous aide à ajuster ce programme uniquement. Le Guide de solutions utilise des informations sur votre patient et sur la programmation de l'aide auditive enregistrées dans COMPASS pour suggérer des solutions spécifiques au patient ainsi que des solutions plus générales. Vous pouvez appliquer la plupart des solutions directement depuis le Guide de solutions.

- **Accoutumance** Si votre patient n'a pas l'habitude de porter des aides auditives, vous pouvez régler la fonctionnalité Accoutumance à un niveau inférieur à 4 pendant une certaine période. Cela réduit le gain de manière générale. Lorsque le patient sera habitué aux aides auditives, vous pourrez à nouveau régler la fonctionnalité Accoutumance sur le niveau 4. Accoutumance automatique est également disponible - dans ce cas, les changements de niveau ont lieu automatiquement. Accoutumance est une fonctionnalité générale, ce qui signifie qu'elle couvre tous les programmes définis dans l'aide auditive. L'affichage graphique montre le graphique Sortie/Fréquence, y compris les courbes cibles.

- **Transposition fréquentielle**. Lorsque vous ouvrez la Transposition fréquentielle pour les aides auditives DREAM, vous êtes automatiquement dirigé vers le programme Principal. Pour les aides auditives UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT, le programme précédemment sélectionné reste actif. L'affichage graphique montre l'effet de la transposition fréquentielle. La fenêtre Transposition fréquentielle s'ouvre dans l'onglet Programmes sélectionnés. Vous pouvez y choisir les programmes pour lesquels vous voulez que la transposition fréquentielle soit active. Vous pouvez activer la fonctionnalité pour tous les programmes des aides auditives ou pour certains programmes uniquement. Vous pouvez définir les réglages. Choisissez la Fréquence de départ pour la fonctionnalité et la gamme de fréquences pour laquelle la Transposition fréquentielle sera active. Pour certaines aides auditives, vous pouvez également définir le volume pour la Transposition fréquentielle et activer l'accoutumance pour la Transposition fréquentielle.

- **Gestionnaire des effets Larsen.** Même si le test du Larsen est bon, votre patient peut se plaindre de sifflements dans ses aides auditives, particulièrement dans un environnement calme, ce qui veut

dire que des sifflements ont toujours lieu. Si le fait de réaliser un nouvel embout ou de réduire l'évent n'aide pas votre patient, vous pourrez peut-être solutionner le problème en faisant quelques ajustements dans le Gestionnaire des effets Larsen.

- **Gestionnaire MPO**. La fenêtre Gestionnaire MPO montre les valeurs MPO cibles et, pour les aides auditives DREAM, les valeurs de référence à titre informatif. Vous pouvez définir les niveaux de sortie maximum. Veuillez noter que tout ajustement de cette fonctionnalité influence chaque programme de l'aide auditive.

- **Vérification**. Cette fonctionnalité comprend des outils qui peuvent être utilisés pour configurer l'aide auditive afin d'effectuer des mesures de vérification grâce à un système d'analyse externe de l'aide auditive. Vous pouvez choisir entre le Mode de test adaptatif normal et le Mode de test non adaptatif.

Ce document est fourni sous forme électronique. Vous pouvez faire la demande d'une version papier gratuitement sur http://widex.pro/gps-startup-guide. Délai de livraison estimé à 7 jours ouvrés. Le document est désormais disponible sur http://widex.pro/gps-startup-guide.

Pour plus d'informations et de conseils, ouvrez le Système d'aide depuis la barre de navigation du programme COMPASS ou appuyez sur le bouton F1 de votre clavier.

© Widex. Tous droits réservés

Version du document : 2.0 . Publié : 2019-11