KURZANLEITUNG

COMPASS GPS


HANDHABUNG

Einführung

In dieser Kurzanleitung wird die HANDHABUNG in COMPASS beschrieben. Hier haben Sie Zugriff auf die DEX-Abstimmung, CROS/BiCROS- und die HG-Konfiguration. Bitte beachten Sie, dass es für DEX und CROS/BiCROS eigene Kurzanleitungen gibt.

HG-Konfiguration

Die vier Registerkarten von HG-Konfiguration:

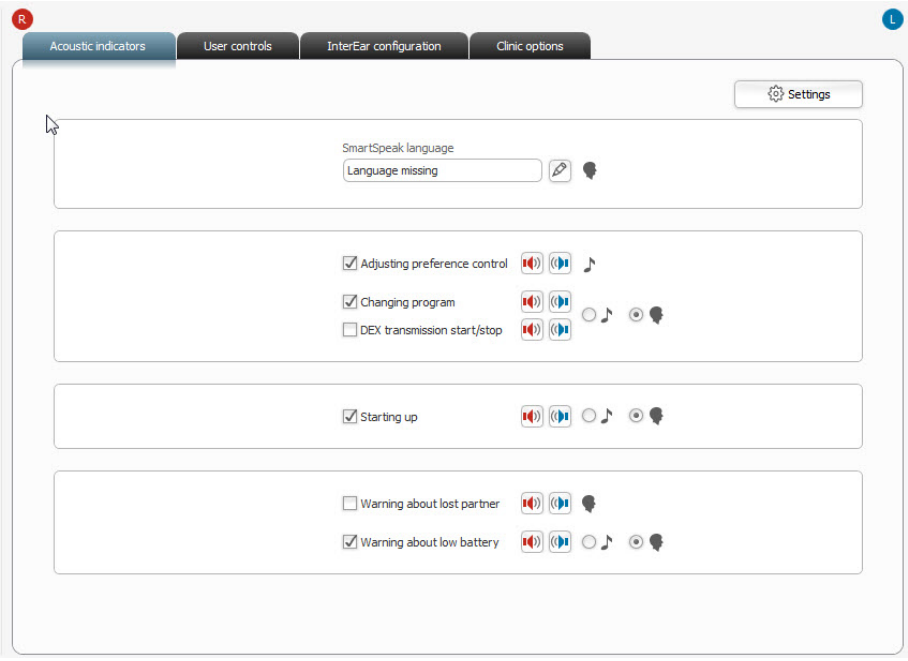

- **Akustische Hinweise:** Hier können Sie die verschiedenen SmartSpeak Sprachmitteilungen und SmartTone Signaltöne nach den Wünschen Ihres Kunde einstellen. Die Sprachmitteilungen bzw. Signaltöne können auch deaktiviert werden. Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen zur Aktivierung/Deaktivierung der Hinweise nur binaural möglich sind und diese standardmäßig aktiviert sind (außer bei ‚Partneralarm' und ‚Beginn der DEX/CROS Übertragung'). Die Registerkarte ermöglicht Ihnen auch den Zugriff auf Lautstärkeeinstellungen und andere Features. Bei einigen Hörsystemen befinden sich diese Einstellungen direkt unter den Ein/Aus-

Einstellungen, während Sie die zusätzlichen Features bei anderen Hörsystemen finden, indem Sie auf die Schaltfläche *Einstellungen* in der oberen rechten Ecke des Fensters klicken. Wählen Sie die bevorzugte Einstellung der Features in der Aufklappliste. Sie können sowohl die Lautstärke der Signaltöne als auch der Sprachmitteilungen einstellen.

- **Bedienelemente:** Hier können Sie die Einstellung der Bedienelemente des Hörsystem (Lautstärkesteller und Programmtaster) verändern. Sie können hier auch den Startmodus konfigurieren.
- **InterEar Konfiguration:** InterEar Features ein- und ausschalten. Die Standardeinstellung ist „Ein“.
- **Optionen für den Akustiker:** Hier können Sie einen Sicherheitscode für die Hörsysteme festlegen sowie die Service-Erinnerung aktivieren. Diese Einstellungen haben keinen Einfluss auf die eigentliche Anpassung, können jedoch für Sie praktische Bedeutung haben. Mit der Service-Erinnerung werden Kunden daran erinnert, dass es an der Zeit ist, die Hörsysteme vom Hörgeräte-Akustiker überprüfen zu lassen. Mit dem Sicherheitscode wird sichergestellt, dass die Anpassung für einen bestimmten Zeitraum nur unter Eingabe dieses Codes ausgelesen bzw. verändert werden kann.

Mobile Connectivity

Einige Hörsysteme können mit mobilen Bluetooth-Geräten gekoppelt werden. Wenn die Hörsysteme Ihres Kunden nicht richtig mit Bluetooth-Geräten funktionieren, können Sie alle Kopplungen in den Hörsystemen löschen und wieder neu einrichten. Dies löst häufig die Probleme. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Fenster *Mobile Connectivity*.
2. Klicken Sie auf *Alle Kopplungen entfernen*. Ein kleines Dialogfenster fragt, ob Sie die Kopplungen entfernen möchten.
3. Klicken Sie auf *Ja*. Dies löscht alle Bluetooth-Kopplungen in den Hörsystemen. Es hat aber keinen Einfluss auf ein mit den Hörsystemen gekoppeltes COM-DEX oder CALL-DEX.
4. Bei den Bluetooth-Geräten (Mobiltelefon, Tablet usw.) entfernen Sie die Kopplung manuell.

Stellen Sie die Bluetooth-Kopplungen der Mobilgeräte manuell wieder her. Beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung des Mobilgeräts zur Herstellung von Bluetooth-Kopplungen.

Einweisung

Unter WEITERE WERKZEUGE finden Sie Hilfe zur DEX Handhabung. Dieses Fenster zeigt Ihnen die DEX Geräte und erklärt die Bedienelemente und Anzeigen. Es ermöglicht Ihnen außerdem den Zugriff auf Demovideos, die die Benutzung der DEX Geräte zeigen.



Weitere Informationen und Ratschläge finden Sie in der Hilfe, die Sie durch Klicken auf das Fragezeichen in der oberen Navigationsleiste von COMPASS oder durch Drücken von F1 öffnen.

Dieses Dokument wird in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Sie können eine kostenlose gedruckte Version dieser Anleitung auf http://widex.pro/gps-startup-guide bestellen, die voraussichtliche Lieferzeit beträgt ca. 7 Kalendertage. Sie können dieses Dokument natürlich auch Herunterladen auf http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Alle Rechte vorbehalten

Dokumentversion: 2.0. Erstellt: 2019-11