QUICK GUIDE

COMPASS GPS


HÅNDTERING

Introduktion

Denne quick guide omhandler HÅNDTERING i COMPASS. Fra dette emne har du adgang til DEX-, CROS/BiCROS og HA-konfiguration. Bemærk, at der er separate quick guides til DEX og CROS/BiCROS.

HA-konfiguration

Vinduet HA-konfiguration består af følgende fire faner:

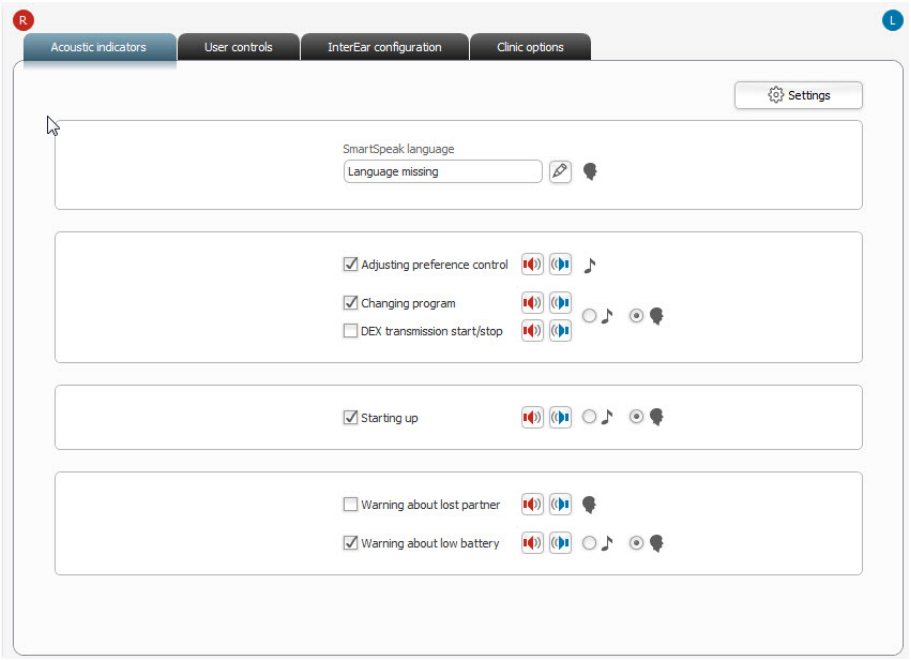

- **Akustiske indikatorer**
  Under denne fane kan du definere de forskellige akustiske indikatorer, som høreapparatet anvender. Her kan du også slå nogle af indikatorerne fra. Bemærk, at indstillingerne for Indikatorer til/fra kun er binaurale, og at funktionerne som standard er slået til (med undtagelse af Mistet partner). Under denne fane har du også adgang til funktionen Niveauforskydning og andre funktioner. På nogle høreapparater er disse indstillinger placeret lige under til/fra-indstillingerne. På andre høreapparater kan du finde ekstrafunktionerne ved at klikke på knappen *Indstillinger* øverst til højre i vinduet. Brug rullelisten til at

vælge de ønskede indstillinger for funktionerne. Du kan forskyde niveauerne for både SmartTone og SmartSpeak.

- **Brugerstyrede kontroller** Her kan du definere indstillingerne for de brugerstyrede kontroller på høreapparatet, f.eks. startindstilling, programstyring og lydstyrkeregulering eller præferencekontrol.
- **InterEar konfiguration** Slå InterEar funktionerne til eller fra. Standardindstillingen er “Til”.
- Klinikvalg Denne fane indeholder funktionerne Påmindelse om Service og Sikkerhedskode. Disse funktioner påvirker ikke den aktuelle tilpasning, men de kan være relevante for dig. Påmindelse om service minder klienten om, at det er tid til at komme til opfølgning på klinikken, og Sikkerhedskoden sikrer, at klientens høreapparater i en specifik periode kun kan tilpasses andre steder, hvis man har adgang til koden.

Mobilkonnektivitet

Nogle høreapparater kan parres med Bluetooth-mobilenheder. Hvis klientens høreapparater ikke kommunikerer korrekt med Bluetooth-enhederne, kan du fjerne alle parringer i høreapparaterne og genetablere dem. Det vil ofte løse problemet. Gør følgende:

1. Åbn vinduet *Mobilkonnektivitet*.
2. Klik på *Fjern alle parringer*. En lille dialogboks åbnes, hvor du bliver spurgt, om du vil fjerne parringerne.
3. Klik *Ja*. Dette sletter alle Bluetooth-parringerne i høreapparaterne. Det påvirker dog ikke nogen COM-DEX eller CALL-DEX, som er parret med høreapparaterne.
4. På Bluetooth-enhederne (mobiltelefon, tablet osv.) fjernes parringerne med høreapparaterne manuelt.

Genetabler Bluetooth-parringerne manuelt på mobilenheder. Følg producentens vejledning om mobilenheden ved etablering af Bluetooth-parringer.

Instruktioner

Under FLERE VÆRKTØJER har du adgang til vinduet for DEX instruktioner. Dette vindue viser DEX enhederne og definerer de forskellige knapper og indikatorer. Det giver dig også adgang til demo-videoer, som viser, hvordan DEX enhederne anvendes.



Du kan få mere information og vejledning ved at åbne Hjælp-systemet fra øverste navigationsbjælke i COMPASS programmet eller ved at trykke på F1-knappen på tastaturet.

Dette dokument leveres i elektronisk form. En papirudgave af vejledningen kan bestilles uden ekstra omkostninger på http://widex.pro/gps-startup-guide. Forventet leveringstid: 7 kalenderdage. Dokumentet findes også på http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Alle rettigheder forbeholdes

Dokumentversion: 2.0. Udstedt: 2019-11