SNABBGUIDE

COMPASS GPS


HANTERING

Inledning

I den här snabbguiden förklaras menyn HANTERING i COMPASS. Du har åtkomst till DEX-, CROS/BiCROS- och HA-konfigurering från den här menyn. Observera att det finns separata snabbguider för DEX och CROS/BiCROS.

HA-konfigurering

HA-konfigureringsfönstret består av följande fyra flikar:

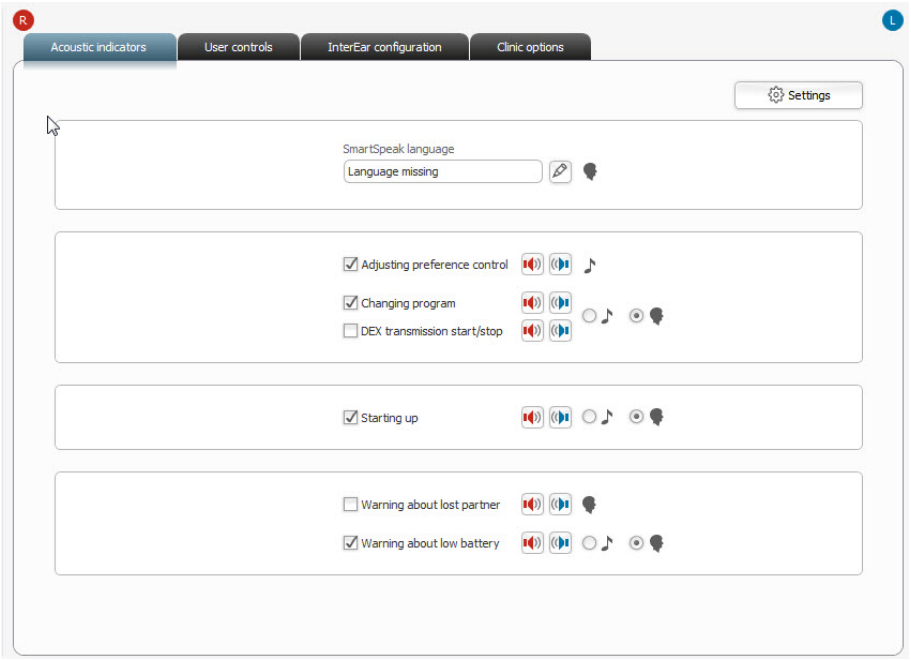

- **Akustiska signaler**. I den här fliken kan du definiera olika ljudsignaler som hörapparaten använder. Du kan även inaktivera vissa signaler. Observera att signalernas på/av-inställning endast är binaural, och att dessa funktioner är påslagna som standard (med undantag för Bruten IE-kommunikation). Du har även åtkomst till funktionerna för nivå på utsänt ljud och andra funktioner under denna flik. För vissa hörapparater är dessa inställningar placerade direkt under på/av-inställningarna, och för andra hörapparater hittar du extrafunktionerna genom att klicka på knappen *Inställningar* i fönstrets övre högra hörn. Använd listrutan

för att välja önskade inställningar för funktionerna. Du kan justera både SmartTone- och SmartSpeak-nivåerna på utsänt ljud.

- **Brukar/användarkontroller.** Här kan du definiera inställningarna för hörapparatens användarkontroller, såsom startläge samt program- och volymkontroll eller preferenskontroll.
- **InterEar-inställningar**. Sätter på eller stänger av InterEar-funktionerna. Funktionerna är påslagna som standard.
- **Klinikalternativ**. Den här fliken innehåller servicepåminnaren och säkerhetskodsfunktionerna. Dessa funktioner påverkar inte den faktiska anpassningen, men kan vara relevanta för dig. Servicepåminnaren påminner klienten om när det är dags att besöka dig igen och säkerhetskoden säkerställer att klientens hörapparater inte kan anpassas någon annanstans under en specificerad tidsperiod, såvida man inte har åtkomst till koden.

Parkoppling

Vissa hörapparater kan paras ihop med mobila Bluetooth-enheter. Om din klients hörapparater inte kommunicerar korrekt med Bluetooth-enheterna kan du ta bort alla parningar i hörapparaterna och återupprätta dem. Ofta löser detta problemet. Gör så här:

1. Öppna fönstret *Parkoppling*.
2. Klicka på *Ta bort alla parkopplingar*. En liten dialogruta öppnas där du tillfrågas om du vill ta bort parningarna.
3. Klicka på *Ja*. Alla Bluetooth-parningar i hörapparaterna tas bort. Det påverkar dock inte eventuella COM-DEX- eller CALL-DEX-enheter som är parade till hörapparaterna.
4. På Bluetooth-enheterna (mobiltelefon, surfplatta osv.) tar du bort parningen till hörapparaterna manuellt.
5. Återupprätta Bluetooth-parningarna manuellt på de mobila enheterna. Följ anvisningarna från tillverkaren av den mobila enheten om hur man återupprättar Bluetooth-parkopplingar.

Gör så här

Under FLER VERKTYG får du åtkomst till fönstret med DEX-instruktioner. I det här fönstret visas DEX-enheterna och här definieras även olika knappar och indikatorer. Här hittar du även demofilmer som visar hur du använder DEX-enheterna.



Detta dokument tillhandahålls i elektronisk form. Du kan begära en pappersversion av instruktionerna utan extra kostnad på http://widex.pro/gps-start-guide – förväntad leveranstid är sju kalenderdagar. Dokumentet är även tillgängligt på http://widex.pro/gps-start-guide.

För ytterligare information och hjälp, öppna Hjälpsystemet från det övre navigeringsfältet i COMPASS-programmet, eller genom att välja F1-knappen på ditt tangentbord.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversion: 2.0. Utfärdat: 2019-11