KRÓTKI PRZEWODNIK

COMPASS GPS


OBSŁUGA

Wprowadzenie

Ten krótki przewodnik dotyczy podstrony OBSŁUGA w programie COMPASS. Mamy tu dostęp do urządzeń DEX, CROS/BICROS oraz do konfiguracji aparatów słuchowych. Należy pamiętać, że istnieją oddzielne Krótkie przewodniki dla urządzeń DEX i CROS/BiCROS.

Konfiguracja aparatu słuchowego

Okno konfiguracji aparatu słuchowego podzielone zostało na cztery zakładki:

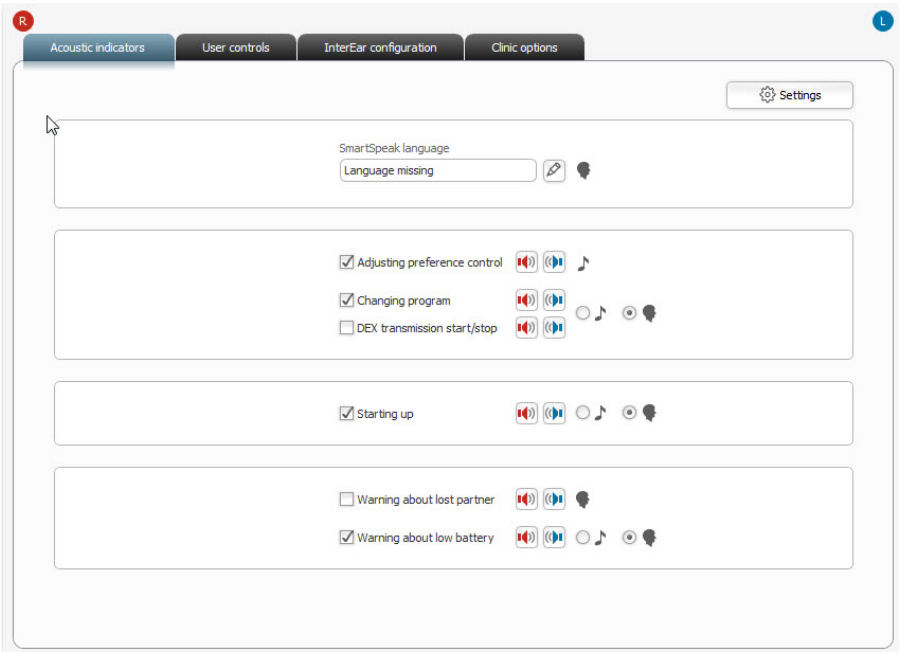

- **Sygnały akustyczne**. Zakładka pozwala definiować różne sygnały akustyczne używane przez aparat słuchowy.Tutaj także można wyłączyć niektóre sygnały. Należy zauważyć, że sygnały załączania są wyłącznie obuuszne I funkcje te są włączone domyślnie (za wyjątkiem Ostrzeżenia braku połączenia). Zakładka umożliwia również przesuwanie poziomu sygnału oraz dostęp do innych funkcji. Dla niektórych aparatów słuchowych, ustawienia te znajdują się bezpośrednio pod przyciskiem włączania/wyłączania, a dla innych aparatów słuchowych, można znaleźć te dodatkowe funkcje, klikając przycisk *Ustawienia*

znajdujący się w prawym górnym rogu okna. Za pomocą listy rozwijanej można wybrać żądane ustawienia dla funkcji. Można przesuwać poziom sygnałów zarówno SmartTone jak i SmartSpeak.

- **Regulatory** – tu można zdefiniować ustawienia regulatorów aparatów słuchowych, takich jak tryb uruchamiania, potencjometr czy przełącznik programów słuchania czy regulacja preferencji.

- **Konfiguracja InterEar** – okno włączania lub wyłączania funkcji InterEar. Ustawieniem domyślnym jest „włączony”.

- **Opcje dla protetyka** – w tej zakładce znajduje się Przypomnienie o przeglądzie oraz funkcje zabezpieczone kodem dostępu. Są to opcje, które nie mają wpływu na parametry aktualnego dopasowania, ale mogą być istotne zarówno dla użytkownika jak i protetyka. Przypomnienie o przeglądzie czyli kontroli serwisowej przypomina użytkownikowi aparatu o zbliżającej się wizycie u protetyka, a kod dostępu chroni aparaty przed niepożądaną ingerencją w parametry dopasowania przez innego protetyka słuchu w określonym czasie.

Łączność mobilna

Niektóre aparaty słuchowe mogą być sparowane z urządzeniami mobilnymi poprzez Bluetooth. Jeśli aparaty słuchowe klienta nie komunikują się poprawnie z urządzeniami Bluetooth, można usunąć wszystkie parowania z aparatów słuchowych i przywrócić je ponownie. To często rozwiąże problem. Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz okno *Łączność z urządzeniami mobilnymi*.

2. Kliknij *Usuń wszystkie parowania*. Otworzy się małe okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz usunąć wszystkie parowania.

3. Kliknij *Tak*. Usunie to wszystkie parowania Bluetooth w aparatach słuchowych. Nie spowoduje to jednak, jakiejkolwiek zmiany dostrojenia/sparowania aparatów słuchowych z urządzeniami COM-DEX lub CALL-DEX.

4. Z urządzeń Bluetooth (telefon komórkowy, tablet itd), usuń ręcznie parowanie z aparatami słuchowymi.

5. Przywróć ponownie parowanie Bluetooth ręcznie w urządzeniach mobilnych. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta urządzenia mobilnego wykonania parowania Bluetooth.

KRÓTKI PRZEWODNIK

Instrukcje

Z zakładki NARZĘDZIA DODATKOWE posiadamy dostęp do okna instrukcji DEX. To okno pokazuje urządzenia Dex i pozwala definiować różne przyciski i wskaźniki. Daje ona również dostęp do filmów demo pokazujących, jak korzystać z urządzeń DEX.



Niniejszy dokument dostępny jest w wersji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji może zostać zamówiona na specjalne życzenie bez dodatkowej opłaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-guide, a czas oczekiwania na dostawę wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostępny jest również pod adresem: http://widex.pro/gps-startup-guide.

Więcej informacji i instrukcji znajduje się w dziale Pomoc, dostępnym na poziomym pasku nawigacji w oknie programu COMPASS, lub po naciśnięciu klawisza F1.

© Widex. Wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja dokumentu: 2.0. Wydany: 2019-11