QUICK GUIDE

COMPASS GPS


BEDIENING

Inleiding

Deze quick guide geeft uitleg over het thema BEDIENING in COMPASS. U hebt toegang tot DEX, CROS/BiCROS en HT-configuratie vanuit dit thema. Voor DEX en CROS/BiCROS zijn er aparte handleidingen.

HT-configuratie

Het scherm HT-configuratie bestaat uit vier tabbladen:

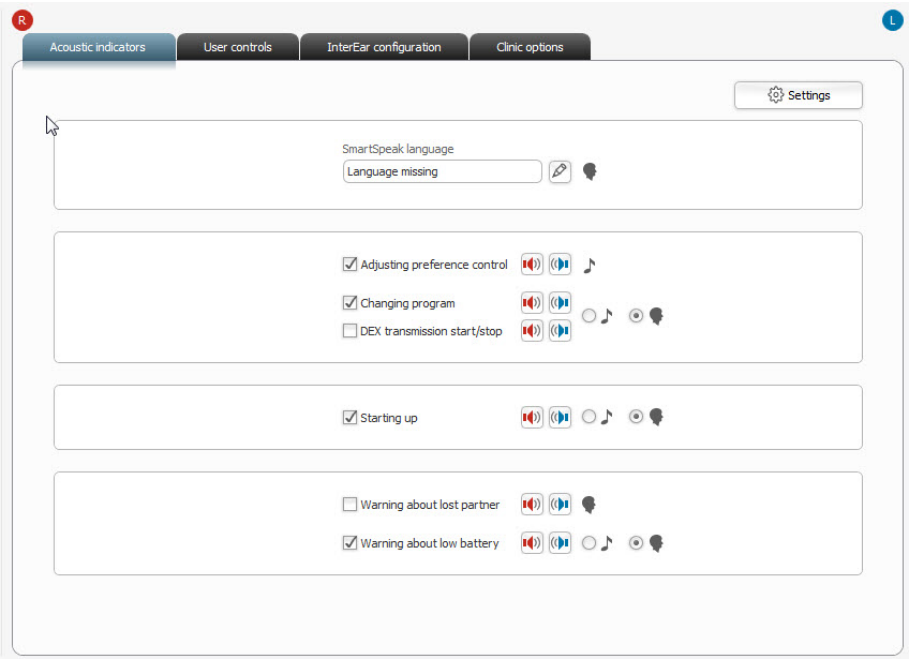

- **Akoestische indicatoren.** In dit tabblad kunt u de verschillende akoestische indicatoren instellen die door het hoortoestel worden gebruikt. Ook kunt u enkele van deze indicatoren uitschakelen. Het in- en uitschakelen van de indicatoren wordt altijd binauraal uitgevoerd en deze features zijn standaard ingeschakeld (behalve Verloren partnerhoortoestel). Onder de aan/uit-instellingen staan de niveau-offset en andere features. Voor sommige hoortoestellen staan deze instellingen direct onder de aan/uit-instellingen en voor andere hoortoestellen kunt u deze extra features vinden door de klikken op de knop Instellingen in rechter bovenhoek van het scherm. Gebruik de rollijst om de gewenste instellingen voor de features te kiezen. U kunt het niveau van zowel SmartTone als SmartSpeak wijzigen.

- **Regelaars voor de gebruiker.** Hier kunt u de instelling van de regelaars voor de gebruiker bepalen, zoals de opstartmodus en de programmaschakelaar of volumeregelaar en de voorkeursregelaar.

- **InterEar configuratie.** Schakelt de InterEar features aan of uit. Standaard staat dit ‘aan’.

- **Opties voor audicien**. In dit tabblad vindt u de Service reminder en de veiligheidscode. Deze features hebben geen invloed op de aanpassing, maar het kan wel nodig zijn ze in te stellen. De Service-herinnering laat uw cliënt weten wanneer het tijd is om een afspraak te maken voor een controlebezoek aan u. De Veiligheidscode zorgt dat de hoortoestellen van uw cliënt gedurende een bepaalde periode niet door een ander kunnen worden aangepast, tenzij er toegang is tot de code.

Mobiele connectiviteit

Sommige hoortoestellen kunnen worden gepaard met mobiele Bluetooth-apparatuur. Communiceren de hoortoestellen niet correct met Bluetooth-apparatuur, dan kunt u alle paringen uit de hoortoestellen verwijderen en deze opnieuw tot stand brengen. Hiermee wordt het probleem vaak opgelost. Handel als volgt:

1. Open het scherm *Mobiele connectiviteit.*

2. Kies *Verwijder alle paringen.* Er verschijnt een klein dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u de paringen inderdaad wilt verwijderen.

3. Kies *Ja*. Hiermee worden alle Bluetooth-paringen uit de hoortoestellen verwijderd. Het beïnvloedt echter niet een paring tussen hoortoestellen en een COM-DEX of CALL-DEX.

4. Verwijder handmatig de paringen uit de Bluetooth-apparatuur (telefoon, tablet, etc.).

5. Herstel de Bluetooth-paringen handmatig op de mobiele apparatuur. Volg hierbij de gebruiksaanwijzing van de betreffende mobiele apparatuur over het tot stand brengen van Bluetooth-paringen.

Instructies

Onder MEER MOGELIJKHEDEN hebt u toegang tot het DEX-instructiescherm. Dit scherm toont u de DEX-apparatuur, waarbij de verschillende knoppen en indicators worden benoemd. Ook zijn hier demovideo’s waarin wordt getoond hoe de DEX-apparatuur moet worden gebruikt.



Open voor meer informatie het Help-systeem in de bovenste navigatiebalk in Compass, of door te drukken op F1 op uw toetsenbord.Dit Help-systeem is Engelstalig.

Dit document wordt aangeboden in elektronische vorm. Een papieren versie kan gratis worden opgevraagd op http://widex.pro/gps-startup-guide, de verwachte leveringstijd bedraagt 7 kalenderdagen. Het document is tevens beschikbaar op http://widex.pro/gps-startup-guide.

Copyright © Widex. Alle rechten voorbehouden.

Documentversie 2.0. Uitgave: 2019-11.