QUICK GUIDE

COMPASS GPS


SLUTTBEHANDLING

Introduksjon

Denne Quick guide omhandler SLUTTBEHANDLINGEN i COMPASS. I sluttbehandlingen får her tilgang til DEX, CROS/BiCROS og HA konfigurasjon. Legg merke til at det finnes egne Quick guides for DEX og CROS/BiCROS.

HA konfigurasjon

HA konfigurasjon vinduet inneholder følgende fire foldere:

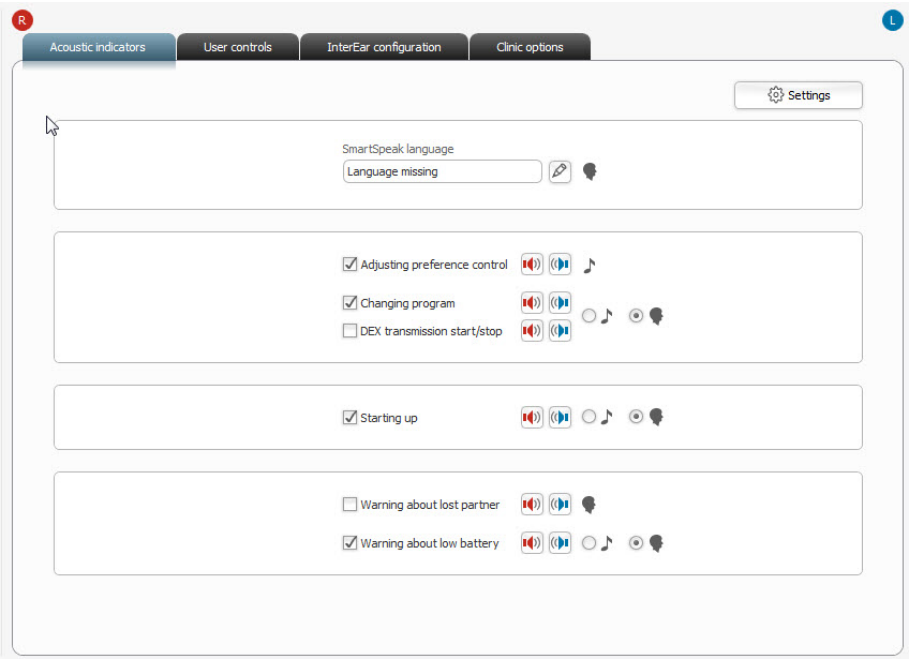

- **Akustiske indikatorer**. Denne folderen lar deg konfigurere de ulike varsellydene som høreapparatet bruker. Den gir deg også muligheten til å deaktivere noen av varsellydene. Legg merke til at indikatorer av/på bare er for binaural tilpasninger, og at disse er slått på som standard (untatt for Mistet Partner). Du har også tilgang til nivå avvik og andre funksjoner under denne folderen. For noen høreapparater er disse innstillingene plassert direkte under av/på, mens det for andre høreapparater kan du finne tilleggs funksjoner ved å klikke på *Innstillinger* i det øvre høyre hjørnet. Bruk drop-down listen for å velge ønsket innstilling og funksjon. Du kan endre nivået for både SmartTone og SmartSpeak.

- **Bruker kontroller.** Her kan du definere innstillingene for bruker kontrollene på høreapparatet, slik som start-opp modus og program og volumkontroll innstillinger.
- **InterEar konfigurasjon.** Slår InterEar features på eller av. Standard innstillinjg er «på».
- **Klinikk valg**. Denne folderen inneholder Service påminnelse og Safety code. Disse innstillingene påvirker ikke selve høreapparattilpansingen.

Mobil tilkobling

Noen høreapparat kan pares med mobile Bluetooth enheter. Dersom brukerens høreapparat ikke kommuniserer riktig med Bluetooth enheten, kan du slette paringen og deretter pare på nytt igjen. Dette vil ofte løse problemet. Gjør slik:

1. Åpne *Mobil Tilkoblings* vinduet.
2. Klikk *Slett alle paringer*. En dialogboks åpner og ber deg bekrefte at du vil slette alle paringer.
3. Klikk *Ja*. Dette vil slette alle Bluetooth paringer i høreapparatet. Legg merke til at dette ikke påvirker COM-DEX eller CALL-DEX som er paret med høreapparatet.
4. På Bluetooth enheten (mobiltelefon, tablet etc.), fjern paringen til høreapparatet manuelt.

   Re-etabler Bluetooth paringen manuelt på den mobile enheten. Følg mobil produsentens guide for hvordan du etablerer en Bluetooth paring.

Instruksjoner

Under MER VERKTØY har du tilgang til DEX instruksjoner. Dette vinduet viser en oversikt over tilgjengelige DEX enheter., med en oversikt over brytere og indikatorer. Den inneholder også videor om bruken av DEX enhetene..



For tilgang til mer hjelp og veiledning, åpne Hjelp systemet fra top-meny-baren i COMPASS programmet, eller ved å trykke på F1 tasten på tastaturet.

Dette dokumentet finnes også I en elektronisk utgave. En papirutgave av denne kan bestilles uten ekstra kostnader på http://widex.pro/gps-startup-guide, antatt leveringstid er 7 kalenderdager. Dokumentet er også tilgjengelig på http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversjon: 2.0. Utgitt 2019-11