GUIDE RAPIDE

COMPASS GPS

SÉLECTION

Introduction

Ce guide traite de la rubrique SÉLECTION dans COMPASS.

⚠	Certaines aides auditives ont un niveau de pression acoustique dépassant 132 dB SPL. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous travaillez avec ces aides auditives, étant donné qu'elles peuvent produire une pression acoustique excessive. COMPASS GPS affiche toujours une boîte de dialogue d'avertissement lorsque vous sélectionnez des aides auditives surpuissantes.

Lorsque vous utilisez REMOTE CARE, sachez que :

⚠	REMOTE CARE est uniquement destiné aux utilisateurs d’aides auditives âgés de 18 ans et plus. REMOTE CARE n’est pas destiné aux utilisateurs d’aides auditives surpuissantes ou de récepteurs surpuissants pour une oreille ou les deux..

Sélectionner une aide auditive

Au milieu de la fenêtre, vous pouvez sélectionner différentes séries, différents modèles, etc. au moyen de listes déroulantes et de boutons. Utilisez les boutons pour voir les aides auditives RIC/RITE, BTE, ITE et CIC, et utilisez les six listes déroulantes pour filtrer les aides auditives afin de n’afficher que les modèles avec les éléments désirés.

GUIDE RAPIDE

Si vous sélectionnez un bouton, comme le bouton *CIC* par exemple, tous les modèles intra-profonds disponibles seront affichés en bas de la fenêtre. Si vous choisissez le bouton *BTE*, tous les contours d'oreilles seront affichés et ainsi de suite. Il en va de même pour les listes déroulantes. Vous pouvez filtrer ce que vous voulez afficher.




Si vous sélectionnez la case *Afficher la plage d'application appropriée*, une marque apparaîtra en bas de la fenêtre derrière ces aides auditives à l'endroit où l'audiogramme de votre patient se situe au sein de la plage d'application.

En bas de la fenêtre, vous pouvez voir toutes les aides auditives disponibles selon les choix que vous avez faits au milieu de la fenêtre. L'affichage que vous obtiendrez sera un affichage personnalisé des aides auditives dans le sens où vous avez choisi les aides auditives que vous voulez voir. Utilisez la barre de défilement horizontale pour voir toutes les aides auditives disponibles.

Informations sur les aides auditives

Utilisez le pointeur de votre souris pour choisir une paire d'aides auditives. Lorsque vous maintenez le pointeur de la souris au-dessus d'une aide auditive, sélectionnez soit l'icône R rouge pour l'oreille droite, soit l'icône L bleue pour l'oreille gauche ou encore l'icône rouge et bleue entre les deux autres. Lorsque vous aurez choisi deux aides auditives, elles s'afficheront en haut de l'espace de travail. Chacun des volets contient ce qui suit :

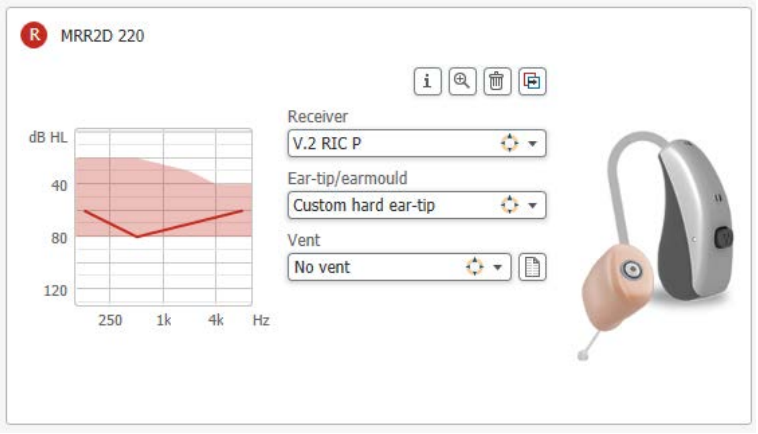

- le nom du modèle de l'aide auditive à côté soit d'une icône R rouge pour l'aide auditive droite, soit d'une icône L bleue pour l'aide auditive gauche
- Audiogramme
- Plage d'application

- Listes déroulantes pour sélectionner un système de maintien auriculaire (selon le modèle d'aide auditive)
- Bouton Information (informations sur l'aide auditive)
- Bouton Zoom
- Bouton Supprimer
- Bouton de copie du système de maintien auriculaire
- Illustration de l'aide auditive (lorsque vous sélectionnez un type de système de maintien auriculaire, l'illustration de l'aide auditive est affichée avec le système de maintien auriculaire en question)
- Bouton pour ouvrir le tableau de conversion des évents qui peut vous aider à choisir le bon évent pour l'embout/le dôme de votre patient.

Ce document est fourni sous forme électronique. Vous pouvez faire la demande d'une version papier gratuitement sur http://widex.pro/gps-startup-guide. Délai de livraison estimé à 7 jours ouvrés. Le document est désormais disponible sur http://widex.pro/gps-startup-guide.

Pour plus d'informations et de conseils, ouvrez le Système d'aide depuis la barre de navigation du programme COMPASS ou appuyez sur le bouton F1 de votre clavier.

© Widex. Tous droits réservés

Version du document : 2.0. Publié : 2019-11