퀵 가이드

COMPASS GPS

설정값 이전

소개

본 퀵가이드는 COMPASS GPS 의 '설정값 이전' 도구에 대해 설명합니다. 이 도구는 '세션 시작' 테마에 위치하고 있습니다. 설정값 이전을 통해 한 보청기의 설정을 다른 하나로 복제할 수 있습니다.

이 도구를 사용하기 전에

설정값 이전 도구는 일부 보청기 시리즈에서만 지원됩니다. 서로 다른 성능수준, 모델, 이어웨어라 하더라도 보청기가 동일한 시리즈라면 설정값을 이전할 수 있습니다.

데이터를 받는 쪽 보청기가 이미 다른 고객에 대해 피팅되어 있어서 그 고객에 맞지 않은 데이터가 포함되어 있는 경우 설정값 이전 과정이 완료되기 전까지 고객이 보청기를 착용하고 있어서는 안됩니다.


EVOKE/MOMENT – 사운드센스 어댑트

만약 고객이 이전의 보청기를 집에서 시험착용하는 동안 생성된 사운드센스 어댑트 데이터를 이전하고자 한다면, 우선 보청기로부터 데이터를 데이터베이스로 내보내기하여 새로운 세션으로 저장해야 합니다. 그 다음 설정값 이전 기능의 절차를 따르면서 새로운 세션을 이전 대상으로 선택하여 진행합니다.

설정값 이전 기능은 설정을 옮기는 것이지, 소리를 옮기는 것이 아님을 유의하세요.


퀵 가이드

데이터 가져오기

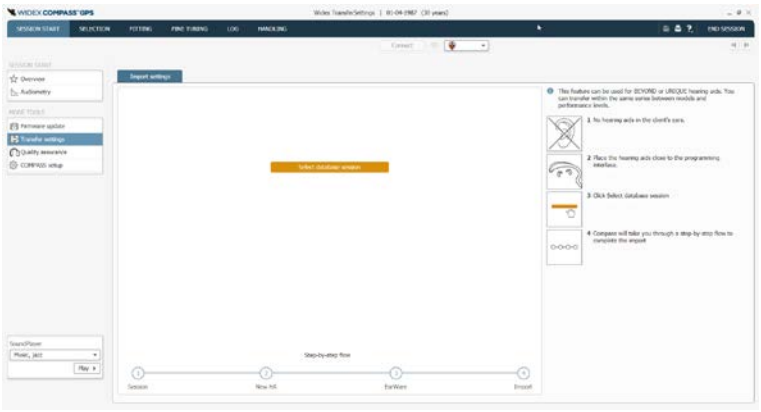


저장된 세션에서 데이터를 가져오려면:


1. ‘세션 시작’ 창에서 ‘설정값 이전’을 선택합니다. ‘데이터 가져오기’ 탭이 이전 설정 창에서 열립니다.
2. 보청기를 탁자 위 피팅장치 가까이에 위치시킵니다 (설정값 이전중에는 고객의 귀에 보청기를 착용시키지 마십시오).

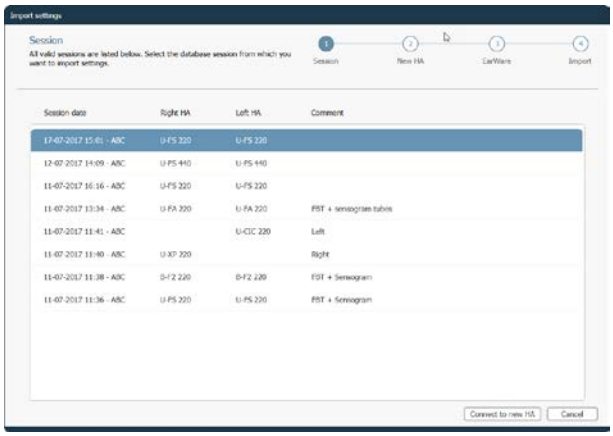

3. ‘데이터베이스 세션 선택’을 클릭하여 데이터베이스에서 가져올 수 있는 모든 세션 목록을 봅니다.
4. 가장 최근의 세션 순으로 모든 세션이 정렬됩니다. 가져올 세션을 선택하고, 연결할 새 보청기를 준비한 후 ‘새 보청기에 연결’을 선택합니다.
5. 인식된 보청기가 표시됩니다. 정확한 보청기, 좌우 방향을 선택한 후 ‘다음’을 클릭합니다.

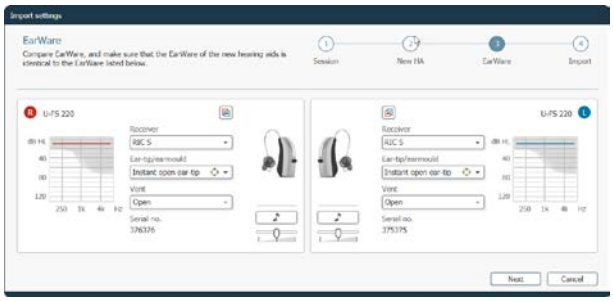

6. COMPASS 가 저장된 세션에서 연결된 보청기와 이어웨어 정보를 표시합니다. 선택한 보청기에 대해 이어웨어 종류를 변경할 수 있는 경우 이 역시 가능합니다. 적절한 이어웨어와 음향조건을 선택한 후 ‘다음’을 클릭합니다.

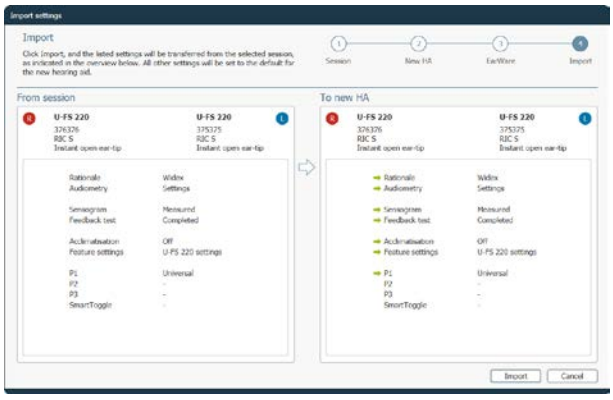

7. COMPASS 가 가져온 데이터의 개요를 표시합니다. 이 개요는 어떤 설정이, 어떻게 이전될 것인지 알려줍니다. 나머지 다른 설정들은 모두 새 보청기의 기본값으로 설정됩니다. 이 최종단계를 수락하면 이 과정을 취소할 수 없습니다. 계속하려면 ‘가져오기’를 클릭합니다.
8. COMPASS 가 데이터를 가져오면서 이전과정이

완료됩니다.

가져오기의 상세정보

가져오기 관련 아래 정보를 참고하세요.

- 모든 청력검사 데이터를 새 보청기로 가져옵니다. 가능한 경우 프로그램, 사운드 클래스, 기능 설정도 이전됩니다.
- 적응 설정값을 가져옵니다. 자동적응이 활성화되어 있으면 특별한 조건이 적용될 수 있습니다.
- 유효한 피드백 및 센소그램의 측정값이 있다면 모두 이전됩니다. 음향조건이 변경되면 (모델, 리시버, 이어몰드, 와이어/튜브 등의 변경) 피드백과 센소그램 값은 이전되지 않으므로 다시 측정해야 합니다.
- 기타 모든 설정은 추천값으로 설정됩니다. 경보음, 사용자 조절기, InterEar 설정, 센터/클리닉 옵션은 기본값으로 설정됩니다.
- 새 보청기에 있던 모든 데이터를 덮어 씁니다.
- DEX/CROS/BiCROS 의 매칭이나 앱은 이전되지 않습니다. 매칭과 페어링은 모두 다시 해야 합니다.

추가 정보와 설명이 필요하신 경우 COMPASS 프로그램의 상단 바에 있는 도움말 기능을 열거나 키보드의 F1 키를 누르시기 바랍니다.

이 문서는 전자형태로 제공됩니다. 이 문서의 종이 버전은 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서 무상으로 요청하실 수 있으며 배송은 영업일 기준 7 일 정도 소요됩니다. 이 문서는 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서도 제공됩니다.

Copyright © Widex. All rights reserved.

Document version: 2.0. Issue date: 2019-11