**COMPASS GPS**

# SIIRRÄ ASETUKSET -TOIMINTO

## Aluksi

Tässä pikaoppaassa käsitellään COMPASS GPS:n Siirrä asetukset -toimintoa. Toiminto löytyy KÄYNNIN ALOITUS -osiosta. Siirrä asetukset -toiminnon avulla voi kopioida kuulokojeen asetukset toiseen kuulokojeeseen.


## Ennen toiminnon käyttämistä

Siirtoasetukset-työkalu ei ole käytettävissä kaikissa kuulokojeperheissä. Asetuksia voi siirtää eri suorituskykyluokkien, eri mallien ja eri EarWare-ratkaisujen välillä, kunhan kuulokojeet ovat samaa tuoteperhettä.

Jos tietoa vastaanottavat kuulokojeet on jo sovitettu toiselle asiakkaalle - ja voivat siten sisältää tietoja, jotka eivät sovellu asiakkaallesi - asiakkaasi EI SAA käyttää kuulokojeita ennen kuin Siirrä asetukset -toiminto on valmis.

**EVOKE/MOMENT – SoundSense Adapt**
Jos haluat sisällyttää siirtoon mitä tahansa SoundSense Adapt -tietoa, jonka asiakkaasi on luonut kokeillessaan aiempia kuulokojeita kotonaan, sinun täytyy ensin hakea tiedot kuulokojeista tietokantaan ja tallentaa haku uutena käyntinä. Valitse sitten tämä uusi käynti perustaksi siirrollesi, kun käyt läpi Siirtoasetuksia.

Huomaa että Siirrä asetukset -toiminto siirtää asetukset, ei ääntä.

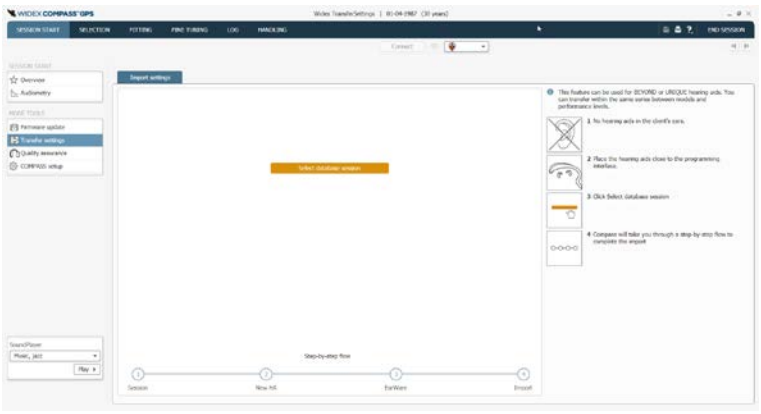


## Hae tiedot

Tietojen hakeminen tallennetusta käynnistä:

1. Valitse *Siirrä asetukset* KÄYNNIN ALOITUS -ikkunasta. Välilehti avautuu Siirrä asetukset -ikkunaan.

2. Laita kuulokojeet pöydälle ohjelmointivälineen lähelle (tietoja EI SAA siirtää kuulokojeiden ollessa asiakkaan korvissa).

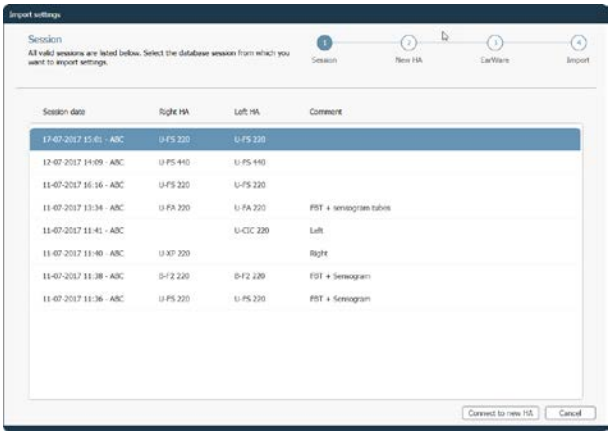



3. Napsauta *Valitse tietokantakäynti* saadaksi näkyviin luettelon käynneistä, joiden tietokannasta voit siirtää tietoa.

4. Kaikki käytettävissä olevat käynnit tulevat näkyviin, uusin ylimpänä. Valitse käynti, jonka haluat siirtää, valmistele uudet kuulokojeet yhteyden avaamista varten ja valitse *Avaa yhteys  uusiin kuulokojeisiin*.

5. Tunnistetut kuulokojeet tulevat näkyviin. Valitse oikeat kuulokojeet, valitse puoli ja napsauta *Seuraava*.




6. COMPASS näyttää yhdistetyt kuulokojeet tallennetun käynnin EarWare-korvaosilla. Jos valittujen kuulokojeiden EarWare-korvaosia on mahdollista vaihtaa, tämä vaihtoehto on käytettävissä. Valitse sopiva EarWare-korvaosakokonaisuus. Vahvista napsauttamalla *Seuraava.*

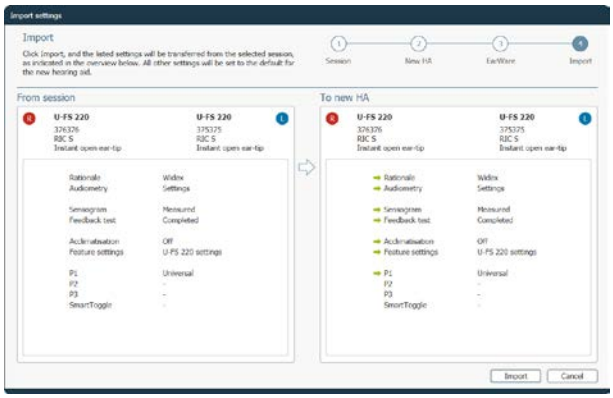


7. COMPASS näyttää yleiskatsauksen siitä, mitä tietoja on siirretty. Tässä yleiskatsauksessa näkyy mitkä asetukset siirretään ja kuinka. Kaikki muut asetukset säätyvät uusien kuulokojeiden oletusarvoihin. Tämä on viimeinen vaihe. Jos tämä hyväksytään, prosessia ei voi enää keskeyttää. Paina *Siirrä* hyväksyäksesi.

8. COMPASS siirtää tiedot ja suorittaa toiminnon loppuun.

## Siirron yksityiskohdat

Huomioi seuraava asetusten siirtämisen yhteydessä

- Kaikki kuulontutkimustiedot siirtyvät uusiin kuulokojeisiin. Ohjelmat, ääniluokat ja toimintoasetukset siirtyvät, jos se on mahdollista.

- Sopeutumisasetukset on siirretty. Käytössä saattaa olla erityisehtoja, kun Automaattinen sopeutuminen aktivoidaan.

- Kaikki mitatut feedback- ja Sensogrammi-arvot siirtyvät, **jos mahdollista**. Jos akustiikkaa on muutettu (vaihdettu malli, kuuloke, korvakappale, johto/letku ym), feedback- ja Sensogrammi-arvoja ei siirretä ja ne täytyy mitata uudestaan.

- Kaikki muut asetukset säätyvät suositeltuihin arvoihinsa. Äänimerkit, Käyttösäätimet, InterEar-valinnat ja Kuulokeskuksen valinnat palautuvat oletusarvoihin.

- Kaikki uusissa kuulokojeissa oleva tieto jää uuden tiedon alle.

- Huomaa etteivät DEX/CROS/BiCROS - tai sovellusten pariliitännät siirry. Kaikki yhdistämiset ja pariliitännät täytyy tehdä uudestaan.

*Lisätietoja ja ohjeita saadaksesi avaa Ohje-tiedosto (HELP) COMPASS-sovitusohjelman ylimmästä navigointipalkista tai painamalla näppäimistön F1-näppäintä.*

Tämä dokumentti on saatavissa sähköisenä. Paperiversio tästä ohjeesta on saatavissa ilmaiseksi osoitteesta http://widex.pro/gps-startup-guide, toimitusaika on noin 7 päivää. Dokumentti löytyy myös osoitteesta http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Kaikki oikeudet pidätetään

Dokumenttiversio: 2.0. Julkaistu: 2019-11