快速指南

COMPASS GPS

转移设置

简介

本快速指南介绍了 COMPASS GPS 中的转移设置工具。您可以在“会话启动”主题下找到该工具。通过转移设置，您可将一台助听器的设置复制到另一台助听器。

使用工具前

转移设置工具不适用于所有助听器系列。只要助听器是同一系列，您就可以在不同的性能水平、不同机型以及使用不同的 EarWare 的设备之间转移设置。

如果用于接收数据的助听器已经配置给另一位客户，由于其中可能包含不适合您客户的数据，因此在转移设置的过程完成之前，您的客户不得佩戴助听器。

EVOKE/MOMENT — 智能声景适应
如果您希望传输包括客户在家中试用以前的助听器时生成的任何智能声景适应数据，则必须先将助听器中的数据导出到数据库，然后将导出的数据保存为新会话。然后在完成传输设置流程时，选择新会话作为传输的基础。

请注意，转移设置功能导入的是助听器设置参数，而不是声音的音质。


导入数据

从已保存的会话导入数据：

1. 在“会话启动”窗口中选择*转移设置*。“转移设置”窗口中会打开*输入设置*选项卡。


快速指南

2. 将助听器放置在桌上靠近编程界面的地方（不建议在客户佩戴助听器时，进行转移设置的操作）。

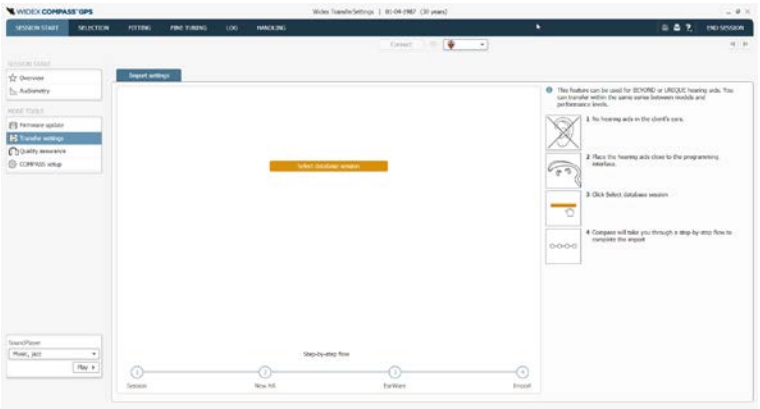

3. 单击*选择数据段会话*，获取从数据库导入的所有有效会话的列表。


4. 将显示所有有效的会话，最新的会话显示在顶部。选择您想要导入的会话，准备新的助听器进行连接，并选择*连接到新的 HA*。

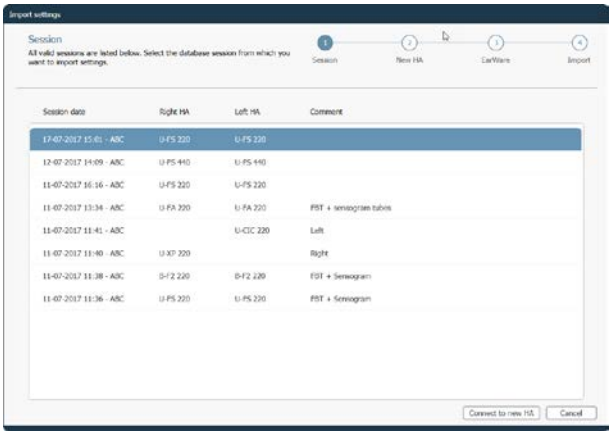

5. 显示检测到的助听器。选择正确的助听器，选择所需的一侧，然后点击 *下一步*。

6. COMPASS 将显示保存会话中与助听器连接的 EarWare。如果可以更改所选助听器的 EarWare，则允许访问此选项。选择合适的 EarWare 和声学特性。如需确认，请单击 *下一步*。

7. COMPASS 将显示导入数据的概览。此概览指示将转移哪些设置以及如何转移。新助听器的所有其他设置将被设置为默认值。这是最后一步，一旦确认，就无法取消该转移过程。若确认转移，单击*输入*。

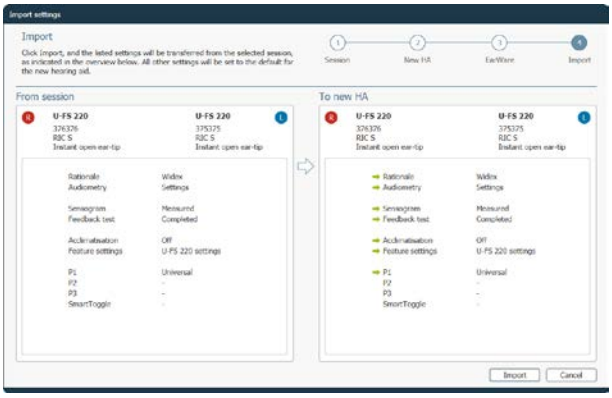

8. COMPASS 将导入数据，该过程即完成。

有关数据导入的详细信息

请注意有关数据导入的以下内容

- 所有听力检测数据都将导入新的助听器。如果可能，还会导入程序、声音水平和功能设置。
- 适应性设置也会被导入。当自动适应性功能激活时，可适用于特定环境。
- **如果可能**，所有反馈测试值和 Sensogram 原位测试值都将被导入。 如果声学特性被更改（更改型号、授话器、耳模、细导声管等），反馈测试值和 Sensogram 原位测试值就不会被导入且需要重新测量。
- 所有其他设置都设置为默认推荐值。警示声音设置、使用者控制、InterEar 配置以及验配机构选项均设置为默认值。
- 新助听器中的任何现有数据都会被覆盖。

快速指南

- 请注意，DEX/CROS/BiCROS 或应用程序的匹配不会被转移。所有匹配和配对都需要重新进行。

如需获取更多信息和指导，请在 COMPASS 程序中使用顶部导航栏或按键盘上的 F1 按钮，打开帮助系统。

本文件将以电子形式提供。如需获取本说明的纸质版，可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 索取，不另行收费，预计交付时间为 7 个日历日。您也可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 查阅本文件。

© Widex. 版权所有

文件版本：2.0。发布日期　2019-11