COMPASS GPS

AYARLARI AKTARMA

Giriş

Bu kısa kılavuzda COMPASS GPS içindeki Ayarları aktarma aracının nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Bu aracı OTURUMU BAŞLAT başlığı altında görebilirsiniz. Bu araç işitme cihazı ayarlarını birinden diğerine kopyalamanızı sağlar.

Aracı kullanmadan önce


Ayarları aktar aracı tüm işitme cihazı modellerinde kullanılamaz. İşitme cihazları aynı model serisine ait olduğu sürece farklı performans düzeyleri, farklı modeller ve farklı KulakTakımı seçenekleri arasında ayarların aktarılmasını sağlar.

Verileri alacak olan işitme cihazı daha önce başka bir hastaya uygulanmış ise – ve sizin hastanıza uygun olmayan veriler içeriyorsa – hastanız Ayarları aktarma işlemi tamamlanana dek işitme cihazını kullanmamalıdır.

EVOKE / MOMENT - Ses Algısına Adaptasyon
Aktarımın, kullanıcının işitme cihazlarını denerken oluşturduğu Ses Algısına Adaptasyon verilerini içermesini istiyorsanız, önce verileri işitme cihazlarından veritabanına aktarmalı ve yeni oturum olarak kaydetmelisiniz. Aktarım ayarları akışından geçerken yeni oturumu transferinizin tabanı olarak seçin.

Ayarları aktarma işlevinin sesi değil, ayarları aktardığını unutmayın.


Verilerin alınması

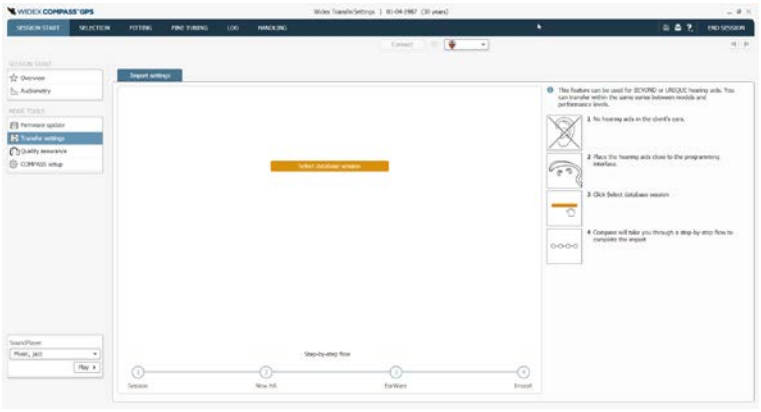

Kaydedilmiş bir oturumdan verileri almak için:

1. OTURUMU BAŞLAT penceresinden *Ayarları aktarma* seçeneğini seçin. Ayarları aktarma penceresinde *Verileri al* sekmesi açılır.


2. İşitme cihazlarını masanızın üzerinde programlama arayüzüne yakın bir yere yerleştirin (İşitme cihazları hastanızın kulağındayken Ayarları aktarma işleminin yapılması ÖNERİLMEZ).

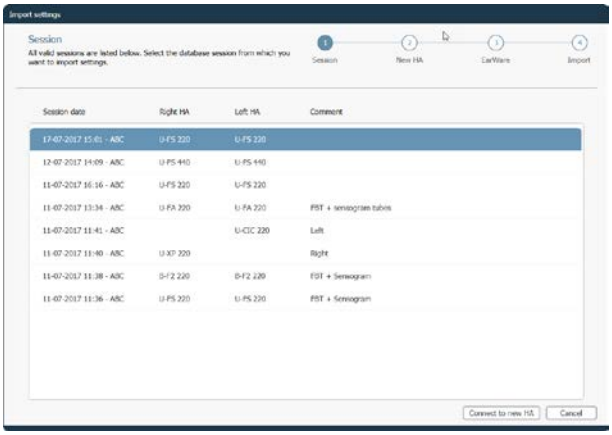


3. Veritabanından alabileceğiniz tüm geçerli oturumları görmek için *Veritabanı oturumunu seç* seçeneğine tıklayın.

4. Tüm geçerli oturumlar en yenisi en üstte olacak şekilde gösterilir. Almak istediğiniz oturumu seçin, yeni işitme cihazlarını bağlantı için hazırlayın ve *Yeni işitme cihazlarına bağlan* seçeneğine tıklayın.

5. Bulunan işitme cihazları gösterilir. Doğru işitme cihazlarını ve tarafını seçin, ve *İleri* seçeneğine tıklayın.

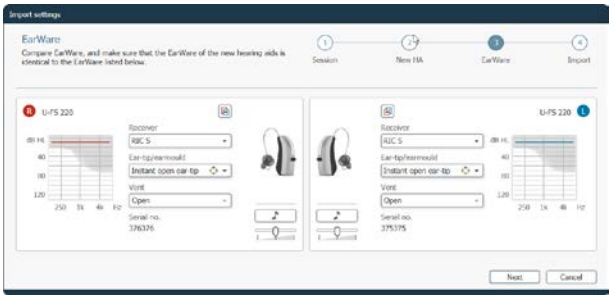

6. COMPASS bağlı işitme cihazlarını kaydedilmiş oturumdan KulakTakımıyla birlikte gösterir. Seçilen işitme cihazlarında KulakTakımının değiştirilmesi mümkünse bu seçenek gösterilir. Uygun KulakTakımı ve akustik kimliği seçin. Onaylamak için *İleri* seçeneğine tıklayın.

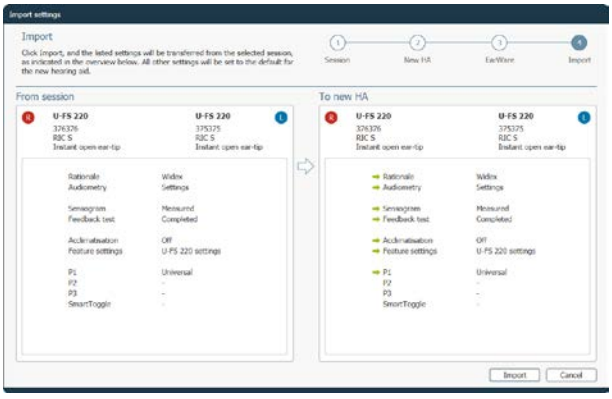

7. COMPASS alınan verilerin bir özetini gösterir. Bu özet hangi ayarların aktarılacağını ve nasıl aktarılacağını belirtir. Yeni işitme cihazlarındaki diğer tüm ayarlar varsayılan değere ayarlanır. Bu son adımdır. Onaylandıktan sonra işlemin iptali mümkün olmaz. Onaylamak için, *Aktar* seçeneğine tıklayın .

8. COMPASS verileri aktarır ve işlem tamamlanır.

Alma işlemi hakkında ayrıntılar

Alma işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilere dikkat ediniz

- Tüm odyometrik veriler yeni işitme cihazlarına aktarılır. Programlar, ses sınıfları ve işlev ayarları mümkünse aktarılır.
- Alıştırma ayarları içe aktarıldı. Otomatik alıştırma etkinleştirildiğinde özel koşullar geçerli olabilir.
- Ölçülen tüm geribesleme ve Sensogram değerleri **mümkünse aktarılır.** Akustik kimlik değiştirilmiş ise (model, hoparlör, kulak-kalıbı, tel/tüpler vb. değişikliği), geribesleme ve Sensogram değerleri gönderilmez ve yeniden ölçüm yapılması gerekir.
- Diğer tüm ayarlar varsayılan değerlere ayarlanır. Sesli uyarılar, kullanıcı kontrolleri, KulaklarArası yapılandırma ayarları ve Klinik seçenekleri varsayılan değerlere ayarlanır.
- Yeni işitme cihazlarında varolan veriler silinir.
- DEX/CROS/BiCROS eşleştirmeleri veya mobil uygulamalar aktarılmaz. Tüm eşleştirmeler yeniden yapılmalıdır.

Ayrıntılı bilgi ve kılavuz için, COMPASS programında üst gezinti çubuğundan veya klavyeden F1 tuşuna basarak yardım sistemini açabilirsiniz.

Bu belge elektronik ortamda sunulmuştur. Basılı form ücretsiz olarak http://widex.pro/gps-startup-guide adresinden istenebilir, tahmini ulaşma süresi 7 gündür. Belge ayrıca http://widex.pro/gps-startup-guide adresinden de edinilebilir.

© Widex. Tüm hakları saklıdır

Belge sürümü: 2.0. Yayınlanma: 2019-11