COMPASS GPS

TRASFERIMENTO REGOLAZIONI

Introduzione

Questa guida veloce vi spiega come utilizzare lo strumento Trasferimento regolazioni di COMPASS GPS. Questo strumento si trova sia nell'area AVVIA SESSIONE. Il Trasferimento regolazioni vi consente di copiare in pochi istanti le regolazioni da un apparecchio acustico all'altro.

Prima di utilizzare questo strumento

Lo strumento Impostazioni Trasferimento non è disponibile per tutte le serie di apparecchi acustici. Oltre a trasferire le impostazioni tra i diversi livelli di prestazioni, è possibile trasferire anche le regolazioni tra i diversi modelli di apparecchi acustici e tra apparecchi che utilizzano configurazioni Auricolari differenti, purché i prodotti prescelti siano della stessa serie.


Si prega di notare che se gli apparecchi acustici utilizzati per ricevere i dati sono già stati provati in precedenza da un altro cliente, potrebbero contenere dati non appropriati. Per questo è importante che il vostro cliente attuale NON indossi gli apparecchi acustici prima che la procedura di trasferimento delle regolazioni sia stata completata.

EVOKE/MOMENT – SoundSense Adapt
Se si desidera che il trasferimento includa i dati SoundSense Adapt che il cliente ha generato durante il periodo di prova dei precedenti apparecchi acustici, è necessario per prima cosa esportare i dati degli apparecchi all’interno del database e salvare l'esportazione come nuova sessione. Quindi, quando si avvia la procedura, selezionare la nuova sessione come base del Trasferimento.

Si prega di notare che la funzione Trasferimento regolazioni importa appunto solo le regolazioni, non il suono.


Dati importazione

Ecco come avvalersi di questa funzione:

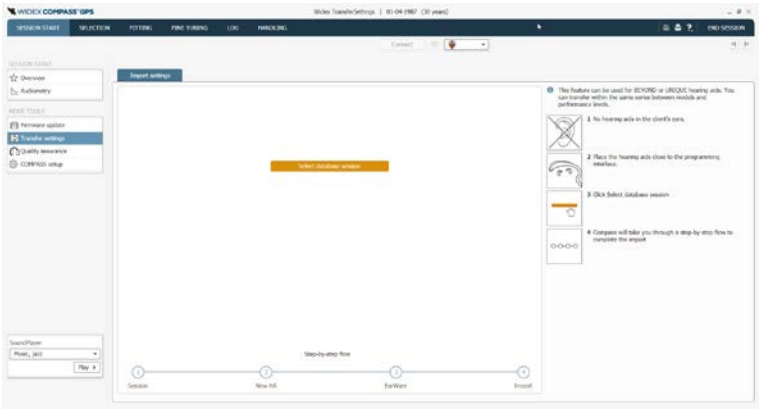


1. Nella schermata AVVIO SESSIONE selezionare la voce *Trasferimento regolazioni.* Nella schermata si apre la scheda *Importazione dati.*

2. Collocare gli apparecchi acustici sul tavolo, vicino all'interfaccia di programmazione (NON bisogna avviare il trasferimento delle regolazioni mentre gli apparecchi acustici sono nelle orecchie del cliente).

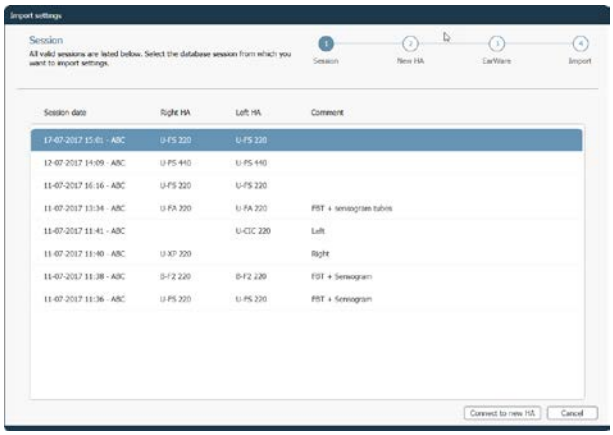


3. Cliccare su *Selezione sessione database* per ottenere l'elenco di tutte le sessioni valide che è possibile importare dal vostro database.

4. Le sessioni valide vengono mostrate in ordine cronologico, con le più recenti in alto. Selezionare la sessione che si desidera importare, predisporre i nuovi apparecchi acustici e cliccare su *Connessione nuovi AA.*

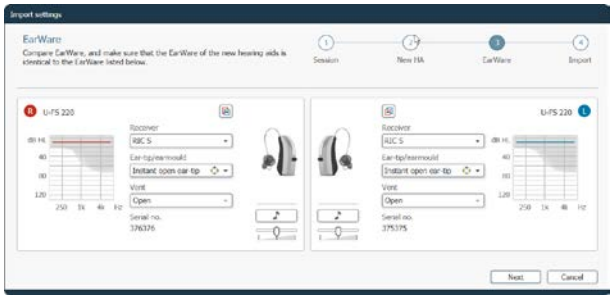

5. A questo punto vengono mostrati gli apparecchi acustici rilevati dal sistema. Selezionare quelli corretti, scegliere il lato e cliccare su *Avanti* per proseguire.

6. COMPASS mostra gli apparecchi acustici collegati con l'Auricolare che è stato scelto nella sessione di fitting effettuata in precedenza. Se per gli apparecchi acustici selezionati è possibile cambiare Auricolare, questa opzione sarà visibile sullo schermo. Scegliere l'Auricolare e le opzioni acustiche adatte. Per confermare, cliccare *Avanti*.

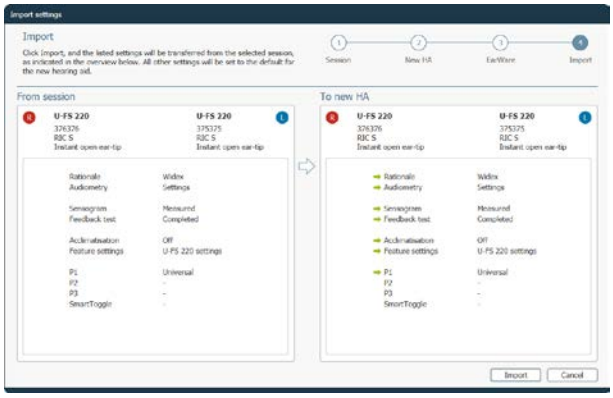

7. COMPASS visualizza un riepilogo contenente i dati importati. Il riepilogo mostra quali regolazioni sono state trasferite e il modo in cui è avvenuto il passaggio. Tutte le altre impostazioni dei nuovi apparecchi acustici restano per ora quelle predefinite. Questo è il passaggio conclusivo. Una volta accettato, non sarà più possibile cancellare la procedura. Per accettare, cliccare su *Importazione*.

8. COMPASS importa ora i dati e porta a compimento la procedura.

Dettagli dell'importazione

Si prega di notare quanto segue:

- Tutti i dati audiometrici vengono importati nei nuovi apparecchi acustici. Se consentito, verranno importati anche tutti i programmi, le classificazioni sonore e le impostazioni delle funzioni.
- Le impostazioni della funzione Acclimatazione vengono importate. Condizioni speciali possono applicarsi quando è attivata l'Acclimatazione Automatica.
- Vengono importati anche tutti i valori misurati del Feedback e del Sensogramma, **se possibile.** Se l'identità o opzione acustica è stata modificata (vale a dire se si è cambiato modello, ricevitore, chiocciola, filo/tubetto ecc.), i valori del feedback e del Sensogramma non vengono importati ed è necessario effettuare di nuovo la loro misurazione.
- Tutte le altre regolazioni vengono impostate sui valori predefiniti consigliati, in funzione del nuovo livello di prestazioni. Avvisatori acustici, Controlli Utente, Configurazione InterEar e Opzioni Cliniche saranno impostate sui valori predefiniti.
- Qualsiasi dato già esistente negli apparecchi acustici nuovi verrà sovrascritto.
- Si prega di notare che gli accoppiamenti DEX/CROS/BiCROS o le app non vengono trasferiti. Pertanto sarà necessario rifare tutti gli accoppiamenti per il paziente.

Per ulteriori informazioni e consigli aprire l'Aiuto dalla barra di navigazione superiore di COMPASS, oppure premere il pulsante F1 sulla tastiera.

Questo documento viene fornito in formato elettronico. La versione cartacea può essere richiesta gratuitamente a http://widex.pro/gps-startup-guide e la si può ricevere via posta in circa 7 giorni lavorativi. Il documento è disponibile anche tramite questo link: http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Tutti i diritti riservati.

Versione documento V2.0. Data pubblicazione: 2019-11