QUICK GUIDE

COMPASS GPS

TRANSFER INNSTILLINGER

Introduksjon

Denne hurtig guiden forklarer Transfer innstillingsverktøyet i COMPASS GPS. Du finner verktøyet under SESJONSSTART. Transfer innstillingene lar deg kopiere høreapparat innstillinger fra et høreapparat til et annet.

Før du bruker verktøyet

Transfer verktøyet er ikke tilgjengelig i alle høreapparatseriene. Du kan overføre innstillinger mellom ulike funksjonsnivåer, ulike modeler med ulike EarWare, så lenge høreapparatene er innenfor same serie.


Dersom høreapparatene som skal motta allerede har vært tilpasset til en annen pasient, og disse datatene ikke passer til den nye pasienten, må pasienten ikke ha på seg apparatene før Transfer prosessen er fullført.

EVOKE/MOMENT – SoundSense Adapt
Dersom du vil at overføringen skal inkluldere SoundSense Adapt data som er samlet opp i løpet av bruksperioden, må du først overføre dataen fra høreapparatet til databasen og lagre som en ny sesjon.

Velg etterpå den nye sesjonen som utgangspunkt når du kobler til apparatet på nytt.

Legg merke til at Transfer funksjonene importerer innstillinger, ikke lyd.

Import av data

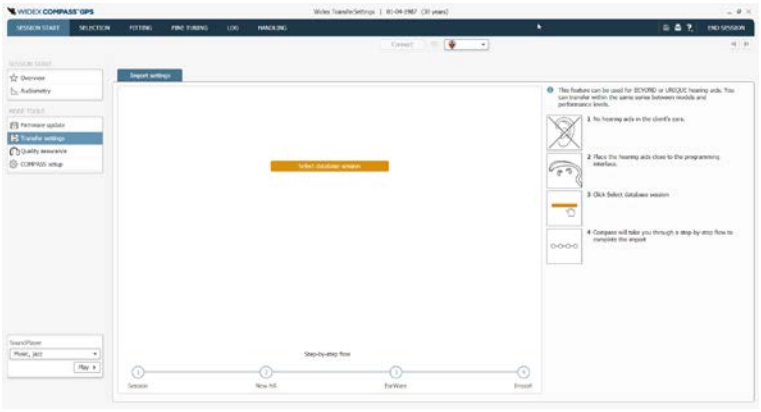


Hvordan importere data fra en lagret sesjon:

1. Velg *Transfer innstillinger* i SESJON START menyen. *Importer data* folderen åpner i Transfer innstillings vinduet.


2. Plasser høreapparatene inntil programmings enheten på bordet (det er ikke anbefalt å overføre innstillingene mens høreapparatene sitter på pasientens ører).

3. Klikk på *Velg database sesjon* for å få en liste over alle gyldige sesjoner for import fra databasen.

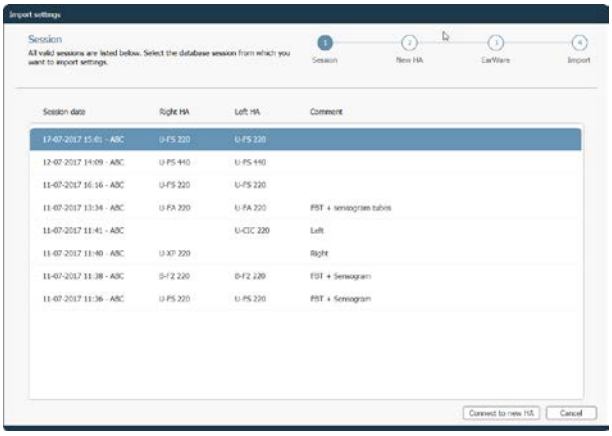


4. Alle gyldige sesjoner vises, med den nyeste på toppen. Velg den sesjonen som du ønsker å impoortere, klargjør høreapparatene for tilkobling og velg *Koble til nytt HA*.

5. Det detekterte høreapparatet vises. Velg riktig høreapparat, side og klikk *Neste*.

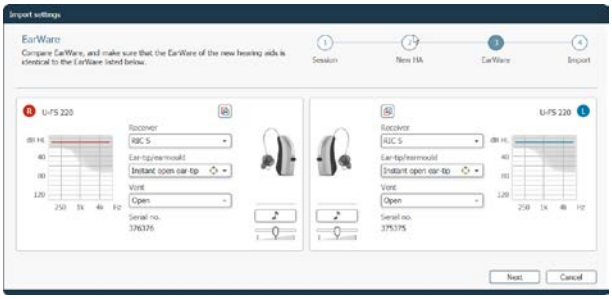

6. COMPASS viser det tilkoblede høreapparatet med EarWare fra den lagrede sesjonen. Dersom det er mulig å endre EarWare for det valgte høreapparatet, vil dette valget være tilgjengelig. Velg riktig EarWare og akustikk. For å bekrefte, klikk *Neste*.

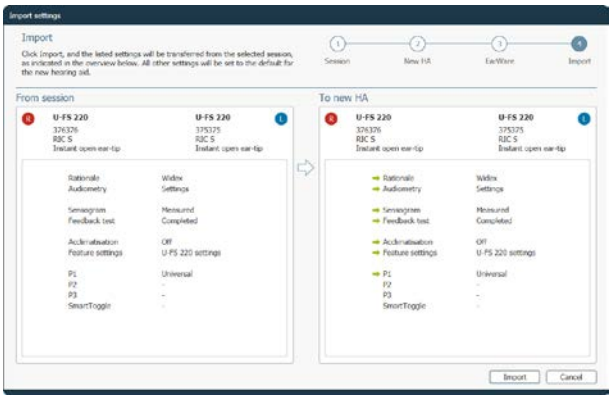

7. COMPASS viser en oversikt over importerte data. Denne oversikten viser hvilke data som vil bli overført, og hvordan. Alle øvrige innstillinger vil bli satt til standard for det valgte høreapparatet Dette er det siste trinnet. Dersom bekreftet, er det ikke mulig å kansellere prosessen. For å bekrefte, klikk *Importer*.

8. COMPASS importerer data, og prosessen er fullført.

Detaljer om importen

Legg merke til følgende angående importen

- Alle audiometriske data blir importert til det nye høreapparatet. Programmer, lydklassene og funksjonsinnstillingene blir importerte dersom det er mulig.
- Innstillingene for tilvenning er viktige. Spesielle forhold kan komme til, når Automatisk tilvenning er aktivert.
- Alle målte feedback og Sensogram verdier blir importert, **dersom det er mulig.** Dersom akustisk identitet har blitt endret (endret modell, receiver, øreprope, wire etc.), vil feedback og Sensogram verdier ikke importert, og må måles på nytt.
- Alle andre innstillinger er satt til sine anbefalte verdier. Akustiske indikatorer, bruker kontroller, InterEar konfigurasjon, og Klinikk valg blir satt til standard.
- Alle eksisterende data i det nye høreapparatet blir overskrevet.
- Legg merke til at matching av DEX/CROS/BiCROS eller APPER ikke overføres. All matching og paringer må gjøres på nytt.

For ytterligere informasjon og hjelp, åpne Hjlep systemet fra navigasjonsbaren i COMPASS programmet, eller ved å trykke på F1 knappen på tastaturet.

Dette dokumentet finnes også i en elektronisk utgave. En papirversjon av denne instruksjonen kan bestilles uten ekstra kostand på http://widex.pro/gps-startup-guide, forvent 7 dagers leveringstid. Dette dokumentet er også tilgjengelig på http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversjon: 2.0. Utgitt 2019-11