COMPASS GPS

傳送設定資料

介紹

本快捷導引介紹了 COMPASS GPS 中的傳送設定資料工具. 您可以在預備主題下找到該工具. 傳送設定資料工具允許您將助聽器設定值從一個助聽器複製到另一個.

在您使用此工具前

傳輸設置工具不適用於所有助聽器系列. 只要助聽器是在相同的系列, 您可以在不同的性能等級,不同的型號和不同的耳機之間傳輸設置.


如果預備接受傳輸設定資料的助聽器已經調配給另一個客戶, 因此不符合您客戶所需的設定, 則您的客戶不應在完成傳送設定資料前佩戴該助聽器.

EVOKE/MOMENT – 聲音感覺適應(SoundSense Adapt)
如果您希望轉移包括客戶在家中試用以前的助聽器時所產生的任何聲音感覺適應(SoundSense Adapt)數據, 則必須先將助聽器中的數據輸出到資料庫, 然後保存輸出資料為新服務記錄. 然後在完成傳輸設置流程時選擇新服務記錄作為傳輸的基礎.

請注意傳輸設定資料功能是輸入設定值, 不是聲音.

匯入資料


由服務記錄匯入資料:

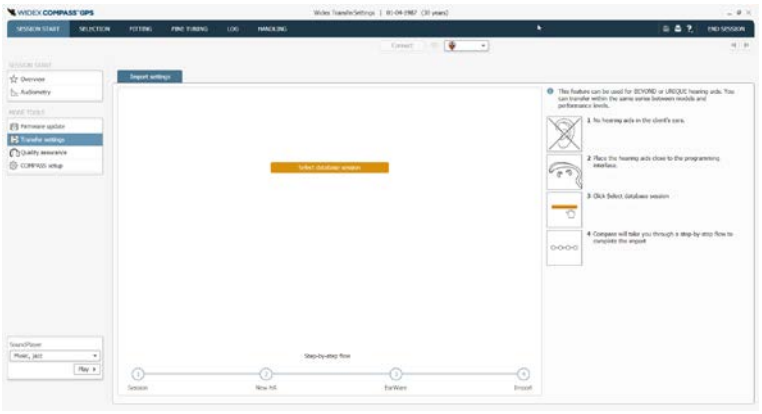

1. 點選預備視窗內的”傳輸設定資料”, 匯入資料選項卡開啟在傳輸設定資料視窗.


2. 將助聽器放在桌上靠近調整介面裝置(不建議助聽器放在客戶耳內時, 進行傳輸設定資料).

3. 點按”選擇服務記錄”, 列出所有可匯入資料的服務記錄.

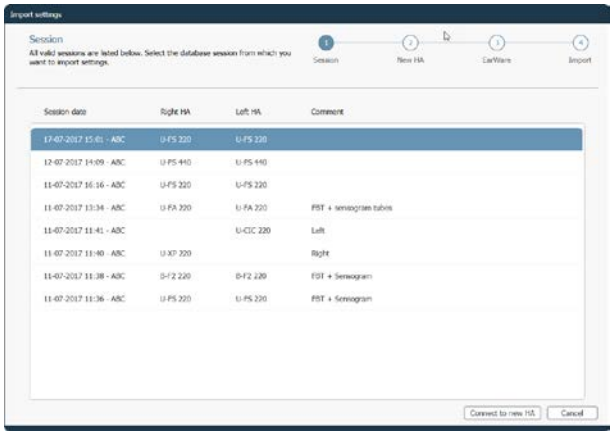


4. 最近的服務記錄排在最上方, 依序向下列出. 選擇您要匯入設定資料的服務記錄, 並連接欲匯入資料的助聽器.

5. 偵測助聽器, 選擇正確的助聽器, 選擇左右耳, 然後點按”下一步”.

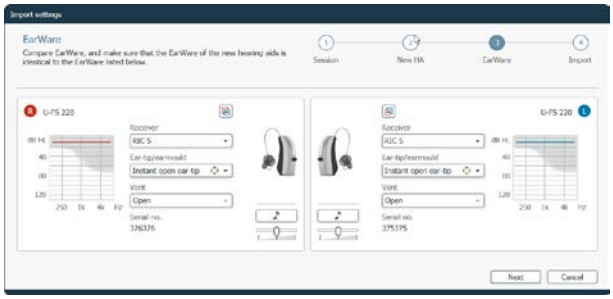

6. COMPASS 顯示所連接的助聽器和服務記錄內的耳機資料. 您也可以換耳機, 然後點按”下一步”.

7. COMPASS 顯示匯入資料的概觀. 這概觀列入那些設定會被傳輸. 所有其他設定將被重設為原廠預設值. 這最後一個步驟. 假如接受, 便點按”匯入”.

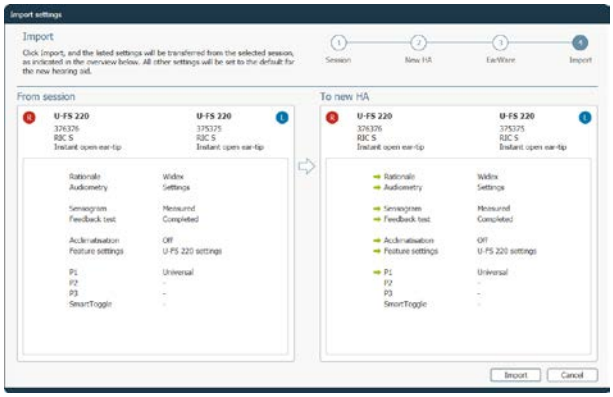

8. COMPASS 匯入資料, 整個過程便完成了.

有關匯入的詳細資訊

請注意有關匯入的以下內容

- 所有聽力測量數據都會匯入新的助聽器. 如果可能, 收聽程式, 聲音類別和功能設置都會被匯入.
- 導入適應設置. 自動適應功能啟動時可能會有特殊情況.
- 如果可能的話, 所有測量的反饋和 Sensogram 的數值都會被匯入. 如果與聲音相關的配置都已經改變 (型號, 喇叭,耳模,耳線/管等), 反饋和 Sensogram 數值便不會被匯入, 並且需要重新測量.
- 所有其他設置都設定為其預設值. 聲音警示,使用者控制,雙耳協調配置和診斷選項設定為預設值.
- 新助聽器中的任何現有數據都將被覆蓋.
- 請注意, DEX / CROS / BiCROS 或 APP 程式的匹配不會匯入. 所有匹配和配對都需要重做.

這種啟動指南是以電子形式提供, 若要紙本, 也可以免費向http://widex.pro/gps-startup-guide 索取, 預計交付時間7天. 啟動指南也可在 http://widex.pro/gps-startup-guide 瀏覽.

若要更詳細的資訊, 請開啟 Compass 程式的導覽列中的小幫手, 或按鍵盤上的 F1 按鈕.

© Widex. 版權所有

Document version: 2.0. Issued: 2019-11