COMPASS GPS

CONFIGURAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

Introdução

Este guia rápido explica como usar a ferramenta Configurações de transferência no COMPASS GPS. Vai encontrar a ferramenta no tema INÍCIO DE SESSÃO. Configurações de transferência permite-lhe copiar as configurações de um aparelho auditivo para o outro.

Antes de utilizar a ferramenta

A ferramenta de Transferência de configurações não está disponível para todas as séries de aparelhos auditivos. Pode transferir configurações entre níveis de desempenho diferentes, diferentes modelos e com EarWare diferente, desde que os aparelhos auditivos pertençam à mesma série.


Se os aparelhos auditivos utilizados para receber dados já tiverem sido adaptados a outro cliente - podendo assim conter dados que não se adequam ao seu cliente - o seu cliente NÃO pode usar os aparelhos auditivos antes do processo de Configurações de transferência estar concluído.

EVOKE/MOMENT – SoundSense Adapt
Se quiser incluir na transferência os dados do SoundSense Adapt gerados pelo seu cliente ao experimentar os aparelhos auditivos anteriores em casa, tem primeiro de exportar os dados do aparelho auditivo para a base de dados e guardar a exportação como uma nova sessão. De seguida selecione a nova sessão como base para a sua transferência ao passar pelo processo de Configuração de transferências.

Tenha em atenção que funcionalidade Configurações de transferência importa configurações, e não som.


Importar dados

Para importar dados a partir de uma sessão guardada:

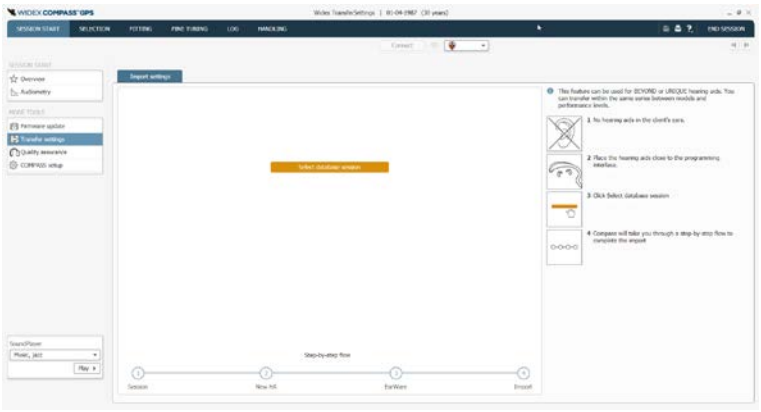

1. Selecione *Configurações de transferência* na janela INICIAR SESSÃO. O separador *Importar dados* abre na janela Configurações de transferência.


2. Cloque os aparelhos auditivos em cima da mesa junto do interface de programação (NÃO é recomendado que transfira as configurações enquanto os aparelhos auditivos não estiveram colocados nos ouvidos dos clientes).

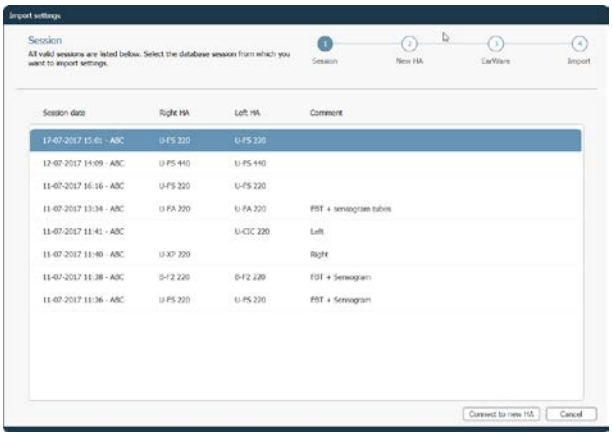


3. Clique *Selecionar sessão de base de dados* para obter uma lista de todas as sessões válidas para importar da base de dados.

4. Todas as sessões válidas serão exibidas, com a mais recente no topo. Selecione a sessão que deseja importar, prepare os aparelhos auditivos novos para fazer a ligação e selecione *Ligar ao novo Aparelho Auditivo*.

5. São exibidos os aparelhos auditivos que foram detetados. Selecione os aparelhos auditivos corretos, selecione lado, e clique *Seguinte.*

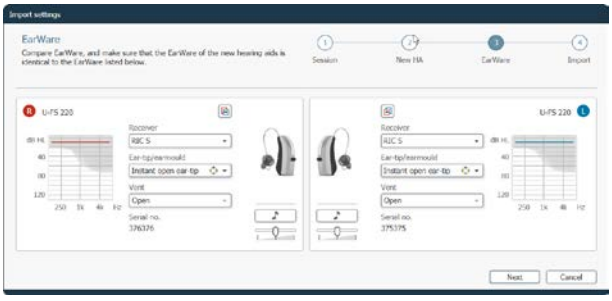

6. O COMPASS exibe os aparelhos auditivos ligados com o EarWare da sessão guardada. É possível alterar o EarWare para os aparelhos auditivos selecionados, este opção está acessível. Selecione o EarWare e acústicas apropriados. Para confirmar, clique *Seguinte.*

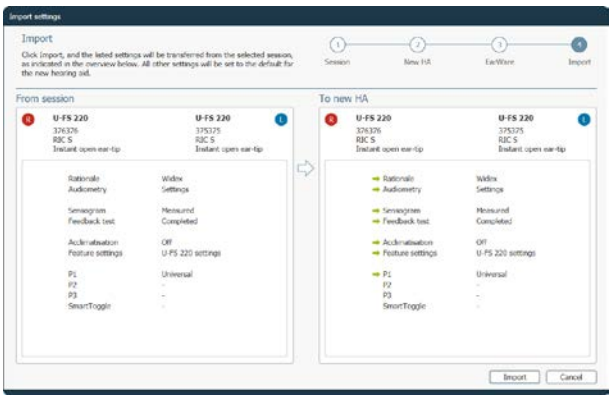

7. O COMPASS exibe um resumo dos dados importados. Este resumo indica quais as configurações a ser transferidas, e como. Todas as outras configurações serão configuradas por defeito para os aparelhos auditivos novos. Este é o passo final Caso seja aceite, já não será possível cancelar o processo. Para aceitar, clique *Importar.*

8. O COMPASS importa os dados e o processo está concluído.

Detalhes sobre a importação

Tenha em atenção o seguinte em relação à importação

- Todos os dados audiométricos são importados para os aparelhos auditivos novos. Programas, classes de som e configurações das funcionalidades são importados, caso seja impossível.
- As configurações de adaptação são importadas. Poderão ser aplicadas condições especiais quando for ativada a Adaptação automática.
- Todos os valores medidos de feedback e Sensograma são importados, **caso seja possível.** Se for alterada a identidade acústica (alteração de modelo, recetor, moldes, fio/tubos etc.), os valores de feedback e Sensograma não serão importados e vão ter de ser novamente medidos.
- Todas as outras configurações ficam definidas para os seus valores recomendados. Indicadores acústicos, Controlos do utilizador, Configuração InterEar, e Opções clínicas são configurados por defeito.
- Todos os dados existentes nos aparelhos auditivos novos são substituídos.
- Tenha em atenção que os emparelhamentos de DEX/CROS/BiCROS ou de aplicações não são transferidos. Todos os emparelhamentos e correspondências têm de ser feitos novamente.

Para mais informação e orientação, abra o sistema de Ajuda na barra de navegação superior do programa COMPASS, ou prima o botão F1 no seu teclado.

Este documento é fornecido em formato eletrónico. Uma versão em papel destas instruções pode ser solicitada sem custo adicional em http://widex.pro/gps-startup-guide, com tempo previsto de entrega de 7 dias. Este documento também está disponível em http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Todos os direitos reservados

Versão do documento: 2.0. Emitida: 2019-11